



INFORME A

ENsayo de Aptitud Concentrado de Cobre

INN – DCN N° C-2304

Noviembre 2024

Instituto Nacional de Normalización
Codelco Chile – División Chuquicamata

Preparó: Ariel Tirado S, Sub-Jefe Laboratorio Designado
Revisión: Carola Fernández, Jefa Laboratorio Designado
Aprobó: William Güin T. Asesor Metrólogo Experto INN

TABLA DE CONTENIDO

1.	Antecedentes Generales	3
2.	Antecedentes del Estudio	5
3.	Plan de Trabajo	5
4.	Laboratorios Participantes.....	6
5.	Identificación y preparación de las muestras	7
5.1	Homogeneidad del material	8
5.2	Test de Homogeneidad.....	9
5.3	Test de Estabilidad.....	10
5.4	Valor Asignado por Laboratorio Químico Organizador	10
6.	Participantes que presentaron resultados	12
7.	Evaluación De Resultados Informados	13
8.	Resultados informados	14
8.1	Resultados individuales por Laboratorio.....	14
8.2	Resultados por Laboratorio y dispersión basados en desviación estándar de los datos	17
8.3	Resultados por Laboratorio y dispersión comparando desviación std vs incertidumbre	19
8.4	Resumen desempeño en error normalizado	22
8.5	Resultados por Elemento para Error Normalizado	23
9.	Analisis de los resultados por Técnica	25
10.	Resumen.....	29
11.	Recomendaciones	29
12.	ANEXOS.....	31
Anexo 1:	Resultados reportados por laboratorios en concentrado de cobre.....	31
Anexo 2:	Metodología de análisis químico utilizado por laboratorio para Minerales	35
Anexo 3:	Evaluación de desempeño de Error Normalizado	40

1. ANTECEDENTES GENERALES

El Laboratorio Químico Central de Codelco es el Instituto Designado y Laboratorio Nacional de Referencia en el ámbito de la Metrología Química para las mediciones y certificación de minerales, concentrados y aleaciones de cobre, según se indica en el decreto supremo N°347 del 17 de diciembre de 2007 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción del Gobierno de Chile.

La colaboración entre Codelco y el Instituto Nacional de Normalización (INN) en la implementación de Rondas Inter-Laboratorios y Ensayos de Aptitud (EA) marca un hito significativo en la búsqueda constante de la excelencia en la industria minera. Estas pruebas, fundamentales en el contexto analítico, desempeñan un papel crucial en la garantía de la calidad y la precisión de los resultados obtenidos en los diferentes procesos mineros.

En el ámbito minero, donde la exactitud de los análisis químicos y físicos es esencial para tomar decisiones cruciales, las rondas de aptitud se convierten en un pilar fundamental. Estas pruebas permiten evaluar la consistencia y la confiabilidad de los métodos de análisis utilizados en múltiples laboratorios, proporcionando una comparación entre distintas instalaciones y técnicas, con la asignación de valor dado por el Instituto Designado. Así, se identifican discrepancias, errores sistemáticos o variabilidades, lo que lleva a mejoras continuas en los procesos, la validación de resultados y, en última instancia, a la optimización de la calidad en la producción minera..

La importancia de estas pruebas radica en su capacidad para fortalecer la confianza en los datos analíticos, lo que se traduce en decisiones más precisas y fundamentadas en el ámbito minero. Al colaborar estrechamente con el INN, Codelco se posiciona como un referente en la implementación de estándares de calidad, reforzando su compromiso con la excelencia operativa y la sostenibilidad en la industria minera.

La colaboración estratégica entre entidades como Codelco y el INN en la ejecución de Rondas Inter-Laboratorio y Ensayo de Aptitud no solo promueve la mejora continua, sino que también impulsa la innovación y el desarrollo de prácticas más eficientes y confiables en la obtención y análisis de datos, consolidando así un sector minero más sólido y competitivo en el escenario global.

Importancia de los Ensayos de Aptitud:

Según la norma ISO 17043 se realiza un programa de participación simultánea en Rondas y/o Ensayos de Aptitud.

Estas pruebas implican la distribución de muestras idénticas a los laboratorios para que realicen análisis, lo que permite comparar y evaluar la precisión y la fiabilidad de los resultados obtenidos por cada uno. La importancia de estos EA es multidisciplinaria:

1. Calidad y precisión de los análisis: Las rondas Inter laboratorios ayudan a evaluar la precisión y la exactitud de los métodos analíticos utilizados por diferentes laboratorios. Permiten identificar posibles variaciones, errores o discrepancias entre los resultados obtenidos por cada laboratorio, lo que ayuda a mejorar y estandarizar los procedimientos.
2. Aseguramiento de la calidad: Son una herramienta fundamental en el aseguramiento de la calidad de los resultados analíticos. Proporcionan retroalimentación sobre la capacidad de los laboratorios para producir mediciones confiables y precisas, lo que contribuye a mantener altos estándares de calidad.
3. Certificación y acreditación: Son un requisito común para la certificación de productos y acreditación de laboratorios. Demostrar la participación exitosa en EA es a menudo un componente clave para obtener o mantener la acreditación, lo que aumenta la credibilidad y la confianza en los servicios de los laboratorios.
4. Identificación de áreas de mejora: Las discrepancias observadas durante los EA pueden identificar áreas de mejora en los métodos de prueba, la calibración de equipos, la capacitación del personal y la gestión de la calidad, lo que permite implementar acciones correctivas y preventivas.
5. Desarrollo de estándares y metodologías: Los resultados de los EA pueden contribuir al desarrollo y la revisión de estándares y metodologías analíticas, ya que proporcionan información valiosa sobre la precisión y la variabilidad en las mediciones. En resumen, los EA desempeñan un papel esencial en la garantía de la calidad, la mejora continua y la confiabilidad de los resultados analíticos, lo que finalmente beneficia a la industria en general al promover estándares más altos y la consistencia en los análisis.

2. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Este informe contiene los resultados del segundo Ensayo de Aptitud, año 2023, para concentrado de cobre, efectuada en virtud de un Convenio de Desempeño suscrito entre el Instituto Nacional de Normalización y la División Chuquicamata de Codelco Chile.

Los Análisis estadísticos basados en las siguientes normas:

- **NCh ISO 17043: 2023** “Evaluación de la conformidad — Requisitos generales para los ensayos de Aptitud”
- **ISO 13528: 2022** “Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison”
- **NCh ISO guía 35: 2017** “Materiales de referencia - Orientación para la caracterización y evaluación de la homogeneidad y la estabilidad”

Los cuales constan de test de homogeneidad, detección de valores anómalos, determinación de Error normalizado mediante valor asignado, para evaluar desempeño de los participantes

3. PLAN DE TRABAJO

La participación de los laboratorios en estas Ensayo de Aptitud permite disponer de una herramienta para evaluar y demostrar la confiabilidad de los datos que producen, principalmente a aquellos que disponen de una acreditación bajo norma NCh-ISO 17025 o están en vías de obtenerla. Por la condición de sistemático, el programa permite evaluar el desempeño de los laboratorios en el tiempo.

El trabajo tiene carácter de cooperativo, es decir, totalmente gratuitos, los laboratorios se comprometen a realizar los ensayos en la forma planificada y entregar los resultados en los plazos establecidos y el laboratorio Organizador/Piloto se compromete a elaborar un informe que se entrega a todos los laboratorios participantes.

La información generada es tratada confidencialmente, INN entregó a cada laboratorio participante un código aleatorio, con el que hicieron llegar sus resultados. En esta ronda se entregó una muestra de concentrado de cobre las instrucciones específicas se dieron a conocer en carta adjunta a las muestras (Protocolo Ronda 2304, Anexo 1).

4. LABORATORIOS PARTICIPANTES

N°	Empresa	Sede
1	Bureau Veritas S.A.	Iquique
2	Bureau Veritas S.A.	Calama- Puerto seco
3	Bureau Veritas S.A.	Antofagasta - La Negra
4	Bureau Veritas S.A.	Caserones
5	Bureau Veritas S.A.	Copiapó
6	Bureau Veritas S.A.	Coquimbo
7	Bureau Veritas S.A.	Santiago
8	Bureau Veritas S.A.	División Andina
9	Codelco	Chuquicamata
10	Codelco	Radomiro Tomic
11	Codelco	El Salvador
12	Codelco	División Ventanas
13	Codelco	División El Teniente
14	SGS Minerals S.A.	Santiago
15	Alfred Knight Group Ltd	Sierra Gorda
16	Alfred Knight Group Ltd	Antofagasta
17	Alfred Knight Group Ltd	Salamanca
18	ENAMI	Fundición H. Videla Lira
19	ENAMI	Laboratorio Planta Delta
20	Geoassay Group	Antofagasta - La Negra
21	Geoassay Group	Santiago
22	Glencore Lomas Bayas S.A.	Antofagasta
23	Minera SPENCE S.A.	Calama
24	Minera Candelaria	Copiapó
25	GEOLAQUIM Ltda.	Copiapó
26	SCM Atacama Kozan	Copiapó
27	METALAB S.A.	Santiago
28	Minera Centinela	Sierra Gorda
29	Soluciones Analiticas SPA	Santiago
30	Andes Analytical Assay spa	Santiago
31	Ecometales	Calama-RT
32	S.C. Minera El Abra	Calama
33	SGS. Minerals S.A.	Calama
34	CCHEN	Santiago
35	WSS S.A.	Santiago
36	SCM Franke S.A.	Taltal

5. IDENTIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS


Las muestras son identificadas con claves y corresponde a concentrado de cobre de yacimientos de las divisiones de Codelco Chile.

Las muestras utilizadas en el EA están identificadas como:

Concentrado: Concentrado de Cobre de Codelco Ministro Hales (MH-CC-01-16)

Se seleccionan 50 kg de concentrado, de una zona específica de la mina o planta para representar una matriz definida y niveles de concentración de los elementos de interés adecuados al propósito del test Ensayo de Aptitud. La muestra es secada, chancada y pulverizada de modo que su granulometría (tamaño de partícula máxima) sea 100% <100#Tyler (0.15 mm), medida por tamizado en seco

Las etapas de división de la muestra se realizaron de acuerdo con el esquema siguiente:

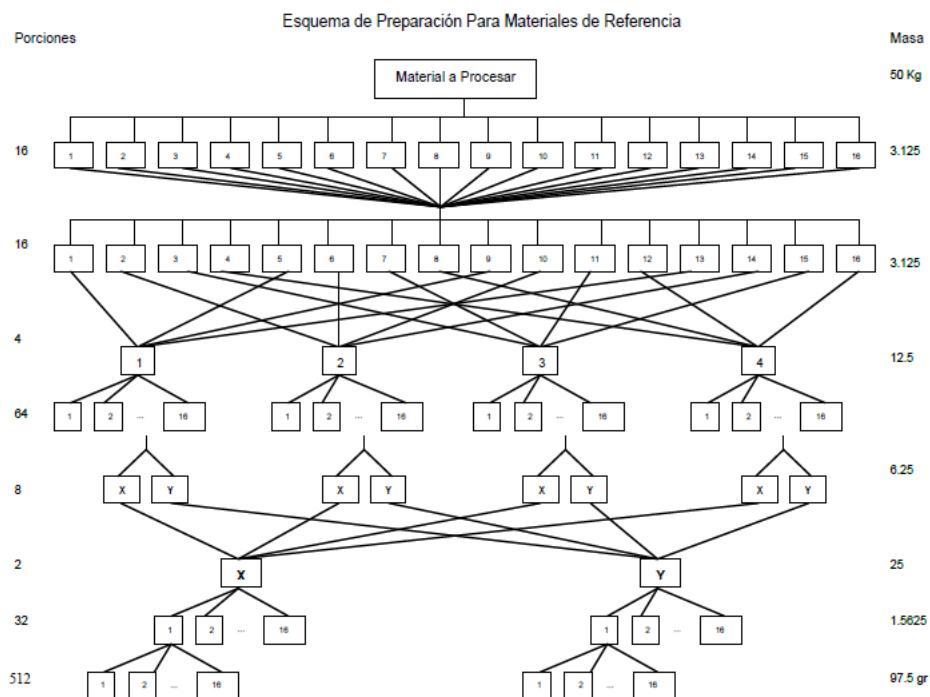

La preparación de Frascos (512 frascos de 97 g c/u aprox.) se realiza en cortador rotatorio.

Se seleccionan 10 muestras en total mediante la metodología random estratificada, 5 muestras de la serie X y 5 muestras de la serie Y para ser sometidas a la prueba de homogeneidad. Según ISO Guide 35:2020 (7.4.1.1)

Se aplicaron métodos estadísticos para la evaluación de la homogeneidad entre y dentro de frascos según ISO Guide 35:2020 (Requisito N° 7)

5.1 Homogeneidad del material

- a) Homogeneidad entre unidades: se realizó mediante la técnica de ANOVA de una vía. Para ello se comparan los resultados 10 grupos por triplicado, dando 30 muestras por analizar. Esto se análisis de datos se realizó mediante el lenguaje Python 3.11 con GUI Jupyter Notebooks.

La prueba de ANOVA (Análisis de varianza) es una técnica estadística utilizada para comparar las medias de tres o más grupos. El objetivo principal del ANOVA es determinar si existe alguna diferencia significativa entre las medias de los grupos y, en caso afirmativo, identificar cuál o cuáles grupos difieren entre sí.

La guía ISO 35:2020:7.7.4 entrega las siguientes fórmulas:

$$S_{bb}^2 = \frac{MS_{Entre} - MS_{dentro}}{n_0}$$

donde

S_{bb}^2 = varianza debida a la heterogeneidad entre unidades

S_{bb} = desviación estándar debido a heterogeneidad entre unidades

MS_{Entre} = cuadrado de las medias (mean square) entre unidades

MS_{dentro} = cuadrado de las medias (mean square) dentro de las unidades

n_0 = número de replicados

- b) Homogeneidad dentro de las unidades: Según indica la guía ISO 35:2020:c.3, para que un MR se acepte como homogéneo, la desviación estándar debida a la heterogeneidad dentro de cada unidad (S_{wb}) debe ser menor a la desviación estándar debida a la heterogeneidad entre las unidades (S_{bb}), independiente que la evaluación estadística indique un P-value menor o igual a 0,05, lo que determinaría que existen diferencias significativas entre las muestras.

$$S_{wb} = S_r = \sqrt{MS_{dentro}}$$

, donde

S_{wb} = desviación estándar debido a heterogeneidad dentro de unidades

S_r = desviación estándar de repetibilidad

MS_{dentro} = cuadrado de las medias (mean square) dentro de las unidades

Según guía ISO 35:2020:7.3, al tener una gran cantidad de elementos o propiedades a determinar, uno puede disminuir esa cantidad escogiendo elementos que sean prioritarios en la muestra, en estos casos se elige los elementos Cobre y Molibdeno como elementos de interés comercial, y el Arsénico como elemento castigable de interés.

5.2 Test de Homogeneidad

Tabla Resumen Test homogeneidad Suficiente:

Se confirma el resultado obtenido a través del cálculo de F, desde ANOVA

	Resultado	F	f-Critico
Elemento Cu	Cumple	1.825735	2.578739
Elemento Mo	Cumple	1.083333	2.578739
Elemento As	Cumple	0.754261	2.578739

Se validan los resultados con el cálculo de p-value desde ANOVA

	Resultado	p-value	p-value
Elemento Cu	Cumple	0.140480	
Elemento Mo	Cumple	0.376102	
Elemento As	Cumple	0.560498	

Nota: el valor del puntaje debe ser interpretado como:

Prueba 1: $F < f\text{-Critico}$

Prueba 2: $p\text{-value} > 0.05$

5.3 Test de Estabilidad

Tiempo de estudio 12 meses, desde febrero del 2022 a marzo 2023

	Ec A	Ec B	A < B
Cobre	0.0001	0.0066 Cumple	
Hierro	0.0400	0.1025 Cumple	
Molibdeno	0.0005	0.0051 Cumple	
Arsenico	0.0033	0.0100 Cumple	
Plata	0.1877	2.5211 Cumple	

5.4 Valor Asignado por Laboratorio Químico Organizador

Para el caso de este material de concentrado de cobre, los valores asignados se realizaron mediante una digestión vía clásica, con ácidos oxidante, posteriormente un acondicionamiento de las muestras en un medio final de ácido clorhídrico, luego las muestras son medidas por la técnica de espectrofotometría de absorción atómica, con una calibración externa de patrones, hierro, molibdeno, arsénico y plata. Para el caso de Cu, este se realiza por volumetría

Los patrones de calibración certificados utilizados para las mediciones instrumentales son:

- Patrón certificado CCU1-E Copper (Cu) MRC
- Patrón certificado NIST 3126a Iron (Fe) Standard Solution
- Patrón certificado NIST 3151 Plata (Ag) Standard Solution
- Patrón certificado NIST 3134 Molibdeno (Mo) Standard Solution
- Patrón certificado NIST 3134 Arsénico (As) Standard Solution

La metodología de análisis químico para asignar los valores de los analitos solicitados es metrológicamente trazable a un Materiales de Referencia Certificados con una incertidumbre de medida.

Para los análisis químicos se utilizaron equipos calibrados e insumos con trazabilidad comprobada como balanza con precisión de 0,01 mg y masas patrones calibrados por el laboratorio custodio de los patrones nacionales de masa CESMEC, Material volumétrico clase A, los ácidos utilizados son categoría ultrapur y agua ultra purificada grado I

Los resultados de los valores asignados obtenidos por el Laboratorio Químico Organizador y correspondiente al mineral enviado es:

Resumen

Elemento	Valor Asignado	U exp
Cu (%)	31.20	0.61
As (%)	3.47	0.17
Ag (mg/Kg)	590	30
S (%)	33.2	1.1

Tabla realizada considerando k = 2

6. PARTICIPANTES QUE PRESENTARON RESULTADOS

Los laboratorios presentaron resultados para los elementos que cuentan con métodos de análisis disponibles.

Nota: Los participantes que reportaron resultados bajo sus límites de detección, no fueron considerados en los cálculos estadísticos.

Concentrado:

Lab.	Cu %	U Exp Cu	As %	U Exp As	Ag mg/Kg	U Exp Ag	S %	U Exp S
1	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
10	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
11	Si	Si						
138-A	Si	Si	Si	Si				
138-B	Si	Si	Si	Si				
138-C	Si	Si						
17	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
20	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
22	Si	Si	Si	Si			Si	Si
23	Si	Si	Si	Si			Si	Si
25	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
27	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
28	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
29	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
31	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
33	Si	Si			Si		Si	
47	Si	Si			Si		Si	
5	Si	Si	Si	Si				
54	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
55	Si	Si	Si	Si				
56	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
63	Si	Si						
8	Si	Si	Si	Si	Si	Si		
Reportado %	100.0	100.0	78.3	78.3	60.9	60.9	52.2	52.2
En %								
Participacion de Laboratorios	69.8							

Los resultados informados por los laboratorios participantes de la ronda INN – DCN-2304 se presentan en las tablas de Anexo N°1 “Resultados informados por Laboratorios”

7. EVALUACIÓN DE RESULTADOS INFORMADOS

Formula de Error Normalizado

$$E_n = \frac{(x - X)}{\sqrt{U_{lab}^2 + U_{ref}^2}}$$

Donde:

x : Resultado del laboratorio participante

X : Valor asignado.

U_{lab} : Incertidumbre expandida del resultado del participante

U_{ref} : Incertidumbre expandida del valor asignado del laboratorio de referencia.

Interpretación de los resultados según ISO 17043:2023:

$|E_n| < 1,0$: Desempeño “Aceptable” y no genera ninguna señal.

$|E_n| \geq 1,0$: Desempeño “No Aceptable” y genera una señal de acción.


8. RESULTADOS INFORMADOS

8.1 Resultados individuales por Laboratorio

Los siguientes gráficos presentan los valores individuales informados por los Laboratorios donde se proporciona una indicación de la dispersión de los resultados.

Concentrado de cobre

Cu

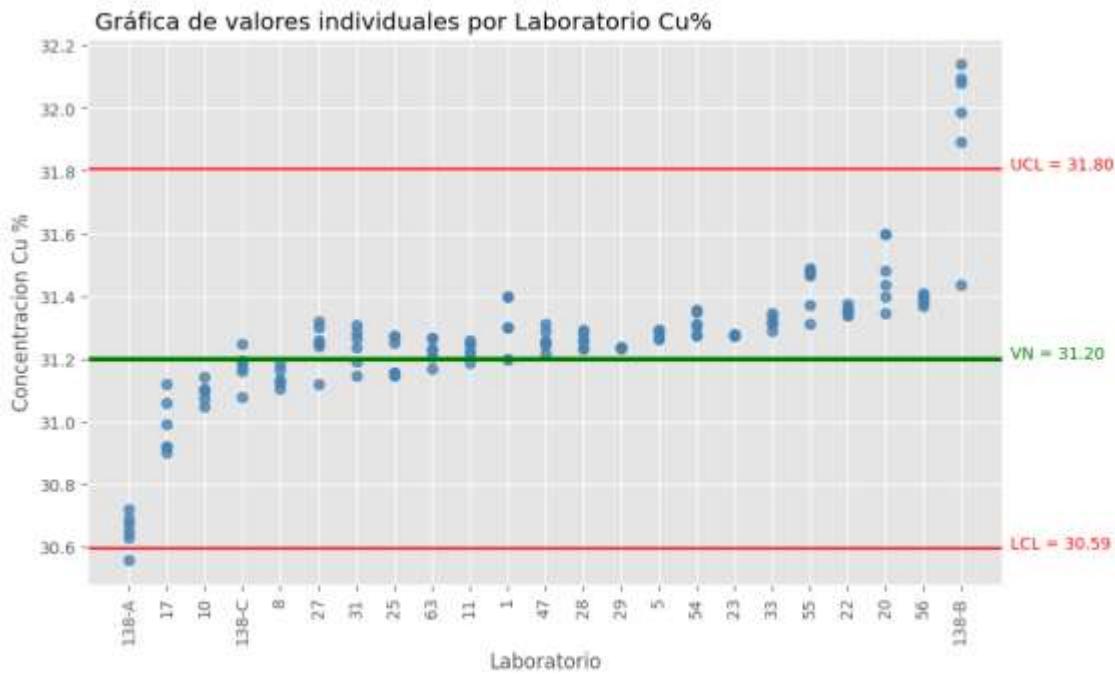


VN: Valor asignado por Laboratorio Químico Organizador (Piloto)


UCL, LCL: Incertidumbre Expandida

As


Gráfica de valores individuales por Laboratorio As%

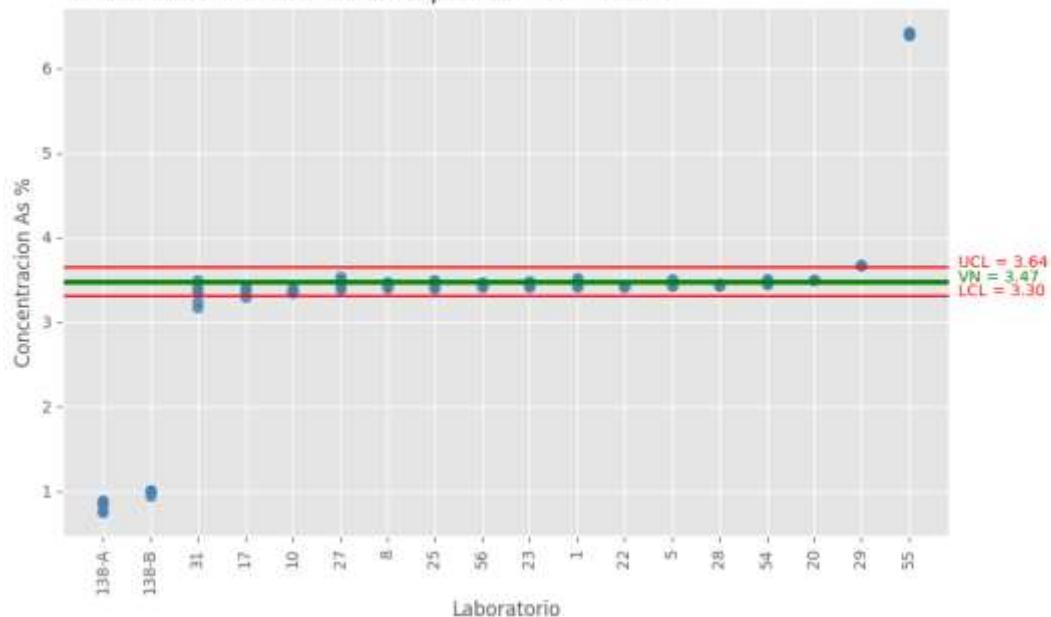**Ag**

Gráfica de valores individuales por Laboratorio Ag mg/Kg

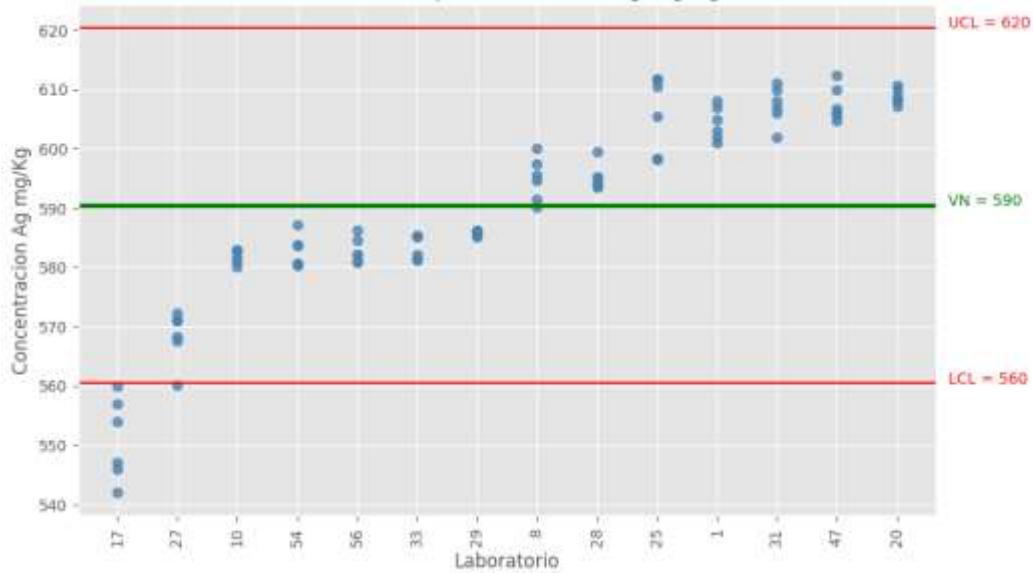

VN: Valor asignado por Laboratorio Químico Organizador (Piloto)
 UCL, LCL: Incertidumbre Expandida

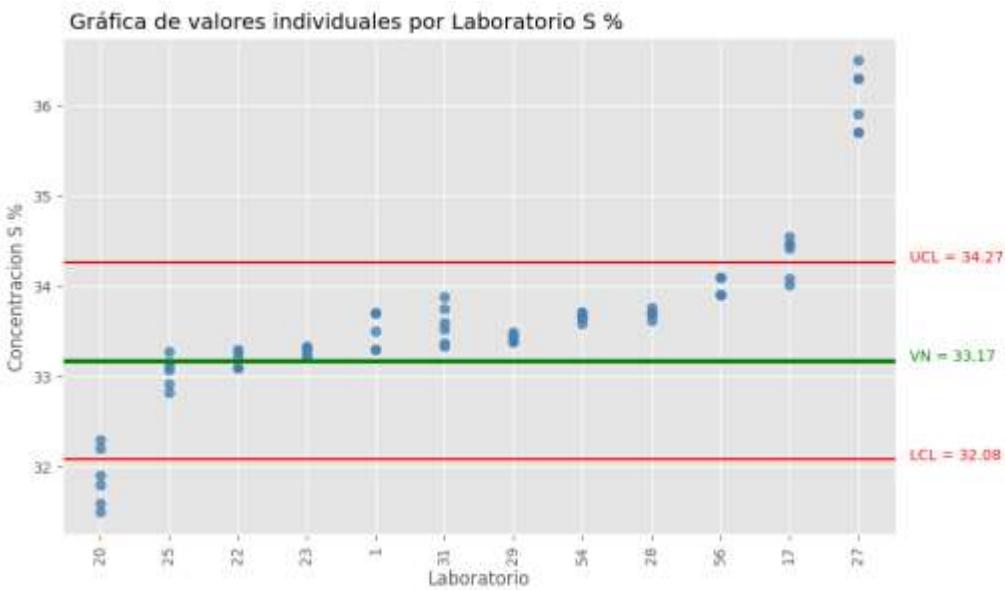
S

VN: Valor asignado por Laboratorio Químico Organizador (Piloto)
UCL, LCL: Incertidumbre Expandida.


8.2 Resultados por Laboratorio y dispersión basados en desviación estándar de los datos

Los siguientes gráficos presentan los promedios por Laboratorio y proporciona una indicación de la dispersión de los resultados, dibujando una línea vertical que corresponde a $\pm 2 \sigma$.



Cu

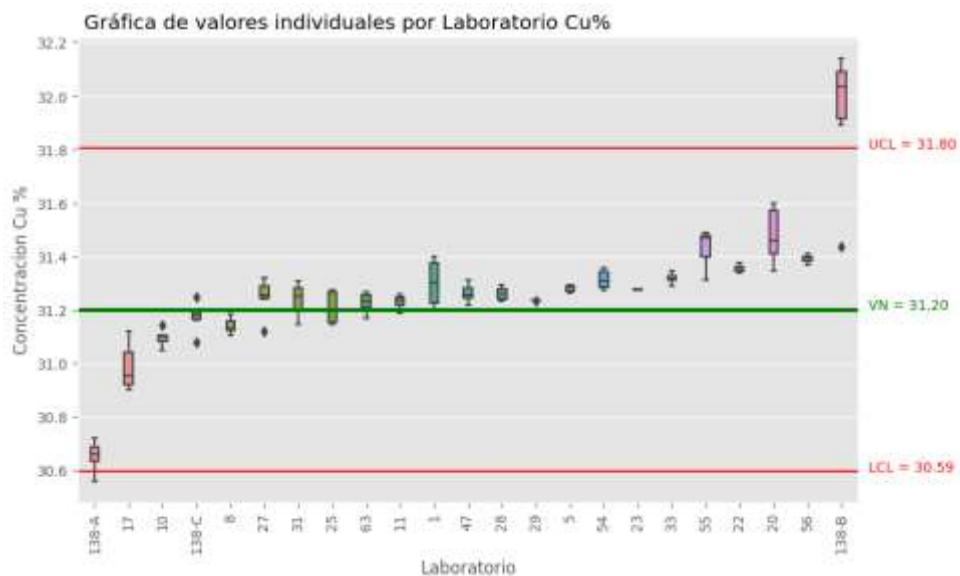

As

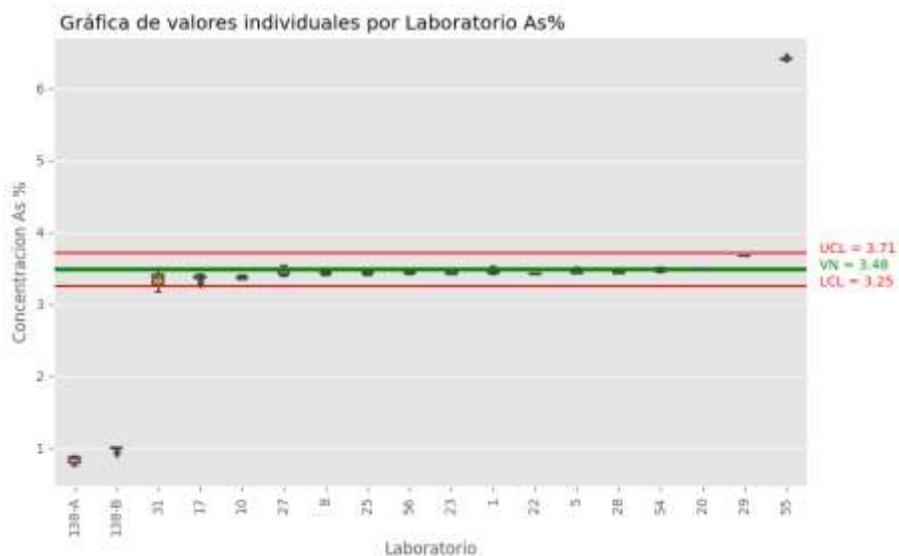

VN: Valor asignado por Laboratorio Químico Organizador (Piloto)
 UCL, LCL: Incertidumbre Expandida

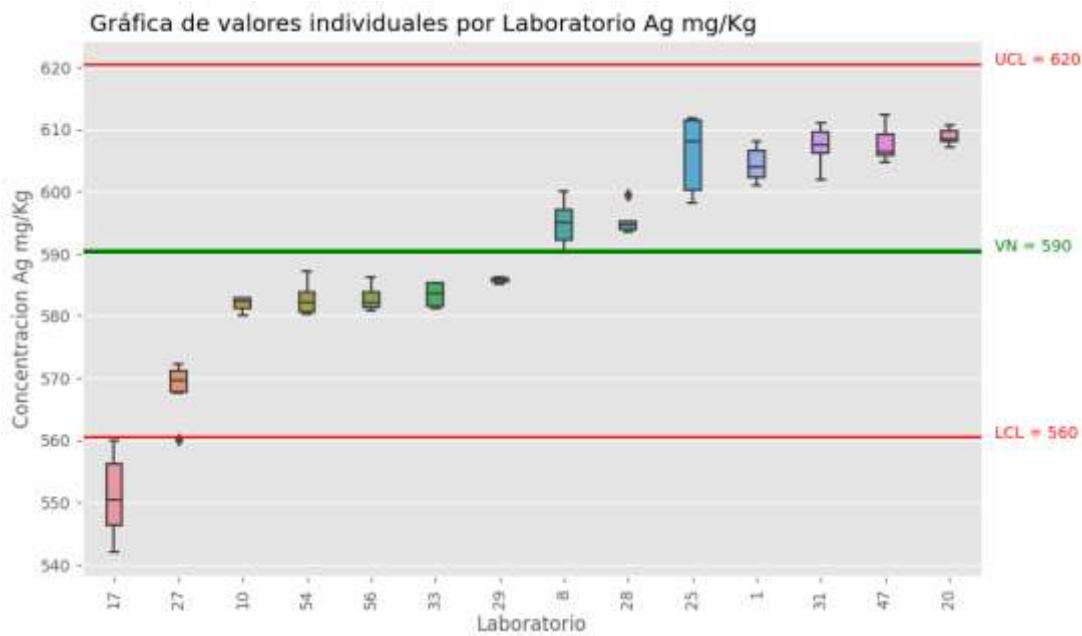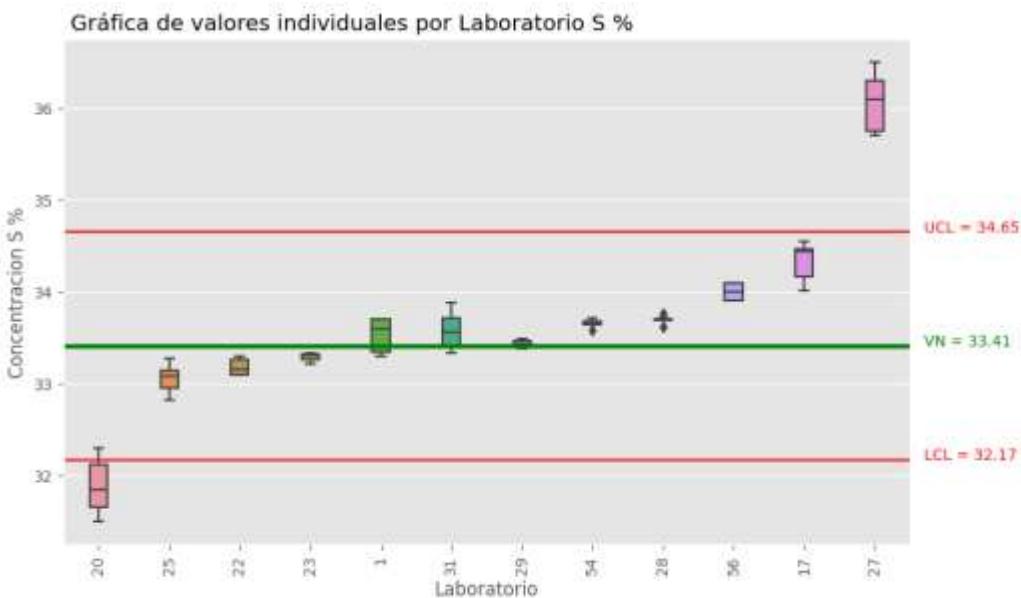
Ag**S**

VN: Valor asignado por Laboratorio Químico Organizador (Piloto)
UCL, LCL: Incertidumbre Expandida

8.3 Resultados por Laboratorio y dispersión comparando desviación std vs incertidumbre

Los siguientes gráficos presentan los promedios por Laboratorio y proporciona una indicación de la dispersión de los resultados, dibujando una línea vertical que corresponde a $\pm 2 \sigma$.

Cu

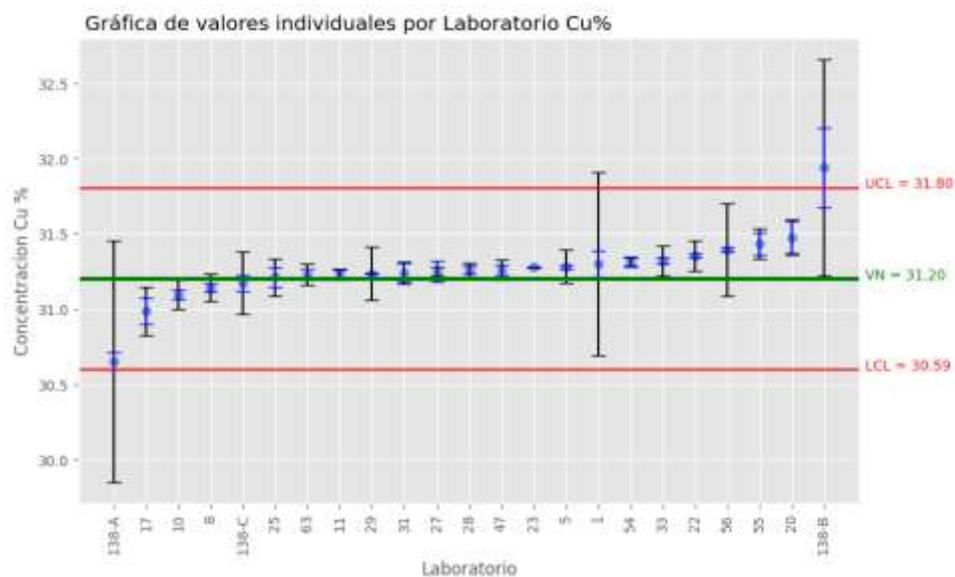


Barra Negra: Incertidumbre


Barra Azul: Desviación estándar

VN: Valor asignado por Laboratorio Químico Organizador (Piloto)


UCL, LCL: Incertidumbre Expandida

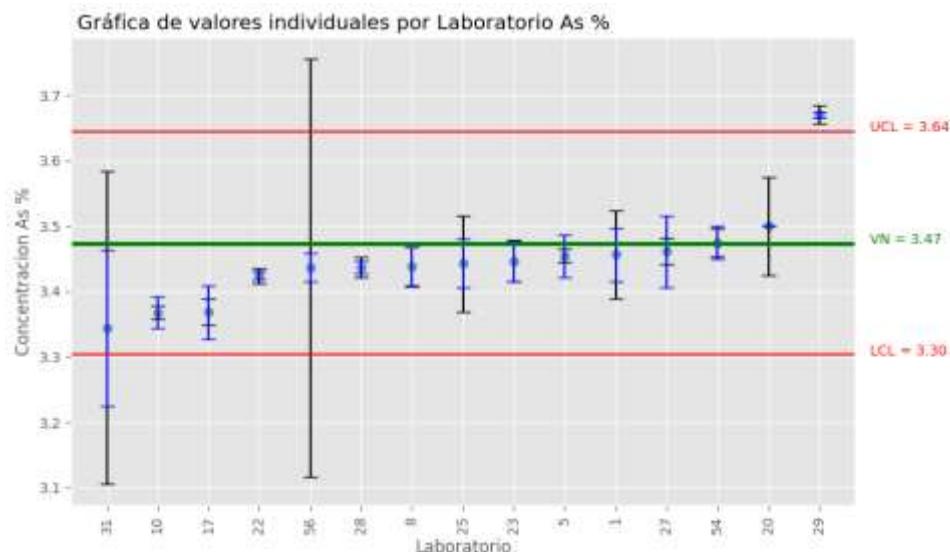As

Por tema de visualización, los laboratorios 138-A; 138-B y 55 fueron sacados de la grafica para ver con claridad la incertidumbre y desviación estándar de los laboratorios que obtuvieron resultados satisfactorios

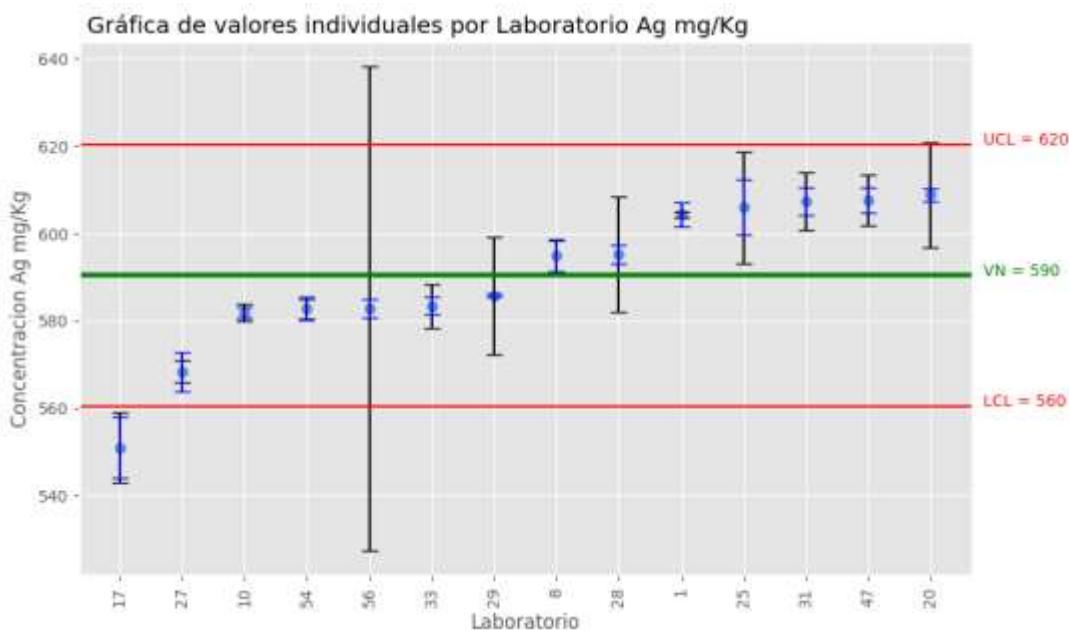Ag

Barra Negra: Incertidumbre
Barra Azul: Desviación estándar
VN: Valor asignado por Laboratorio Químico Organizador (Piloto)
UCL, LCL: Incertidumbre Expandida

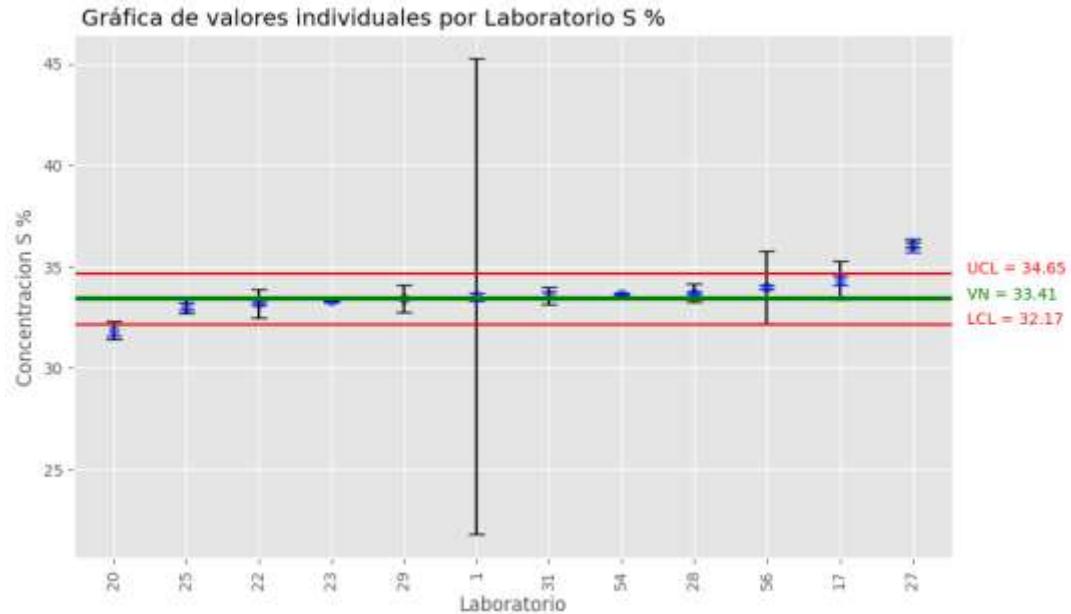S

Barra Negra: Incertidumbre

Barra Azul: Desviación estándar

VN: Valor asignado por Laboratorio Químico Organizador (Piloto)

UCL, LCL: Incertidumbre Expandida

8.4 Resumen desempeño en error normalizado :


A continuación, se presenta con los resultados del desempeño de los participantes:

Lab.	Cu	As	Ag	S
0	1	Aceptable	Aceptable	Aceptable
1	10	Aceptable	Aceptable	Aceptable
2	11	Aceptable	--	--
3	138-A	Aceptable	No Aceptable	--
4	138-B	Aceptable	No Aceptable	--
5	138-C	Aceptable	--	--
6	17	Aceptable	Aceptable	No Aceptable
7	20	Aceptable	Aceptable	Aceptable
8	22	Aceptable	Aceptable	--
9	23	Aceptable	Aceptable	--
10	25	Aceptable	Aceptable	Aceptable
11	27	Aceptable	Aceptable	No Aceptable
12	28	Aceptable	Aceptable	Aceptable
13	29	Aceptable	No Aceptable	Aceptable
14	31	Aceptable	Aceptable	Aceptable
15	33	Aceptable	--	Aceptable
16	47	Aceptable	--	Aceptable
17	5	Aceptable	Aceptable	--
18	54	Aceptable	Aceptable	Aceptable
19	55	Aceptable	No Aceptable	--
20	56	Aceptable	Aceptable	Aceptable
21	63	Aceptable	--	--
22	8	Aceptable	Aceptable	--


Distribución en Cu




Distribución en As

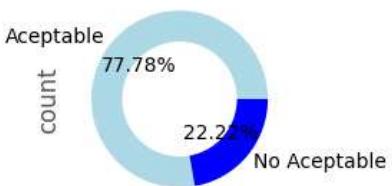

Distribución en Ag

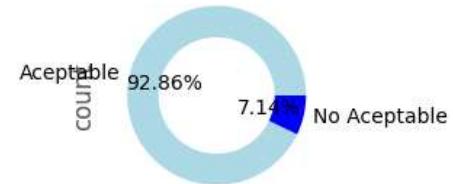


Distribución en S

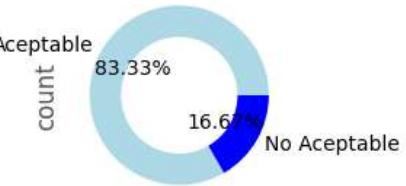




8.5 Resultados por Elemento para Error Normalizado

Cu

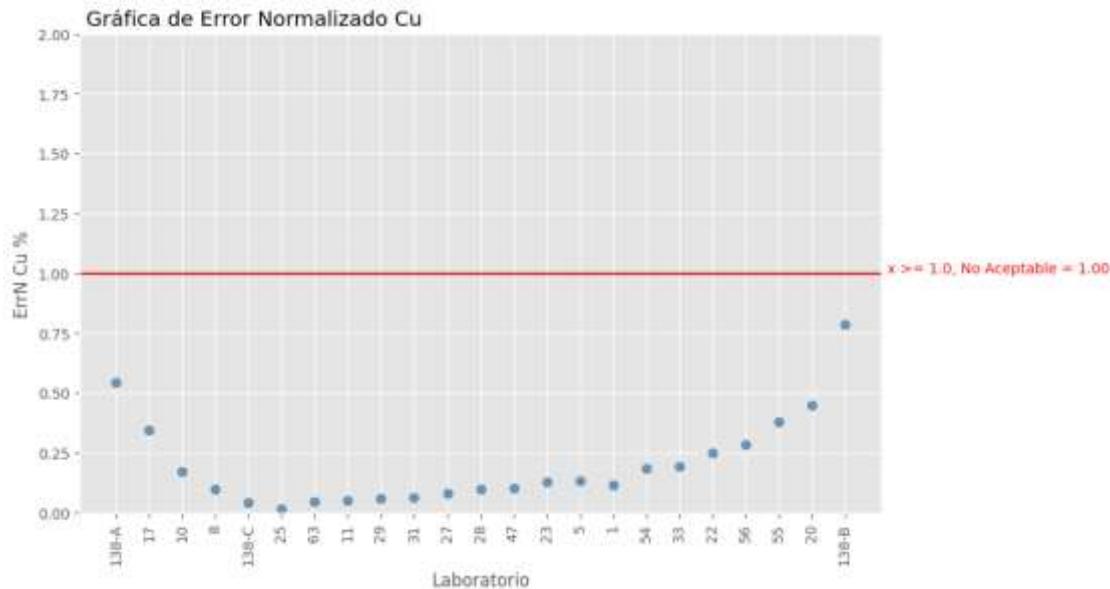


As

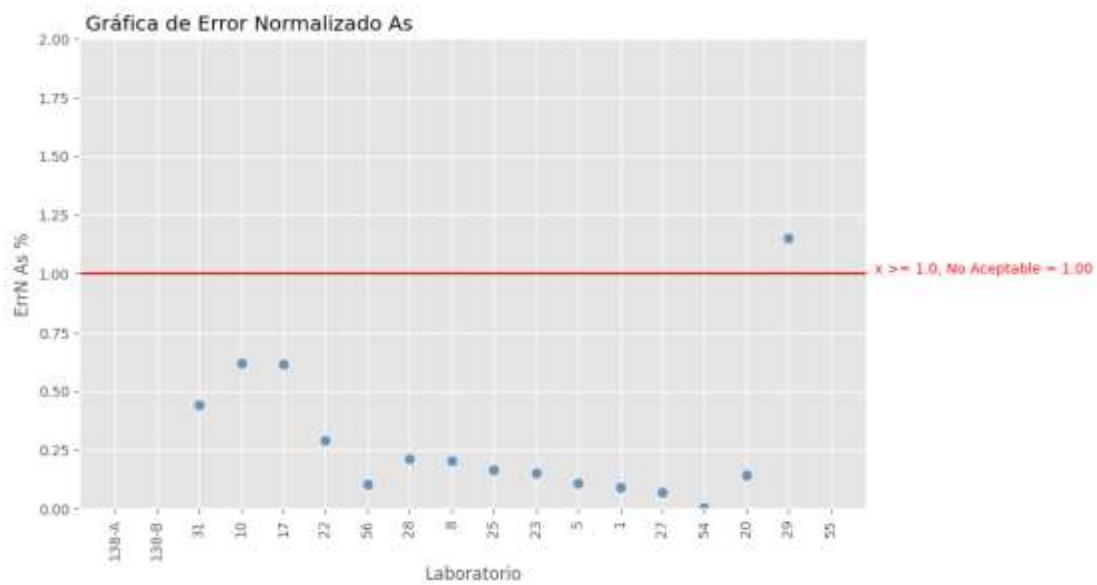

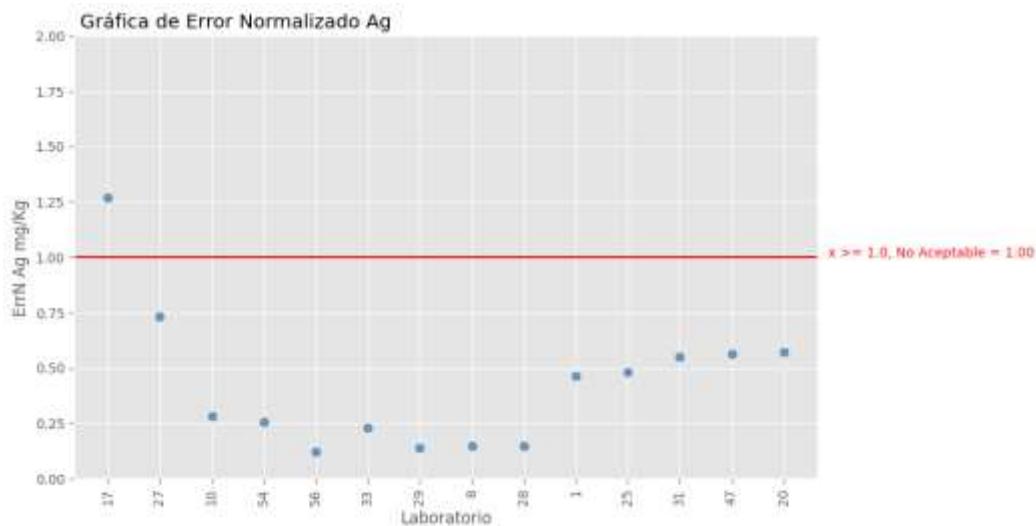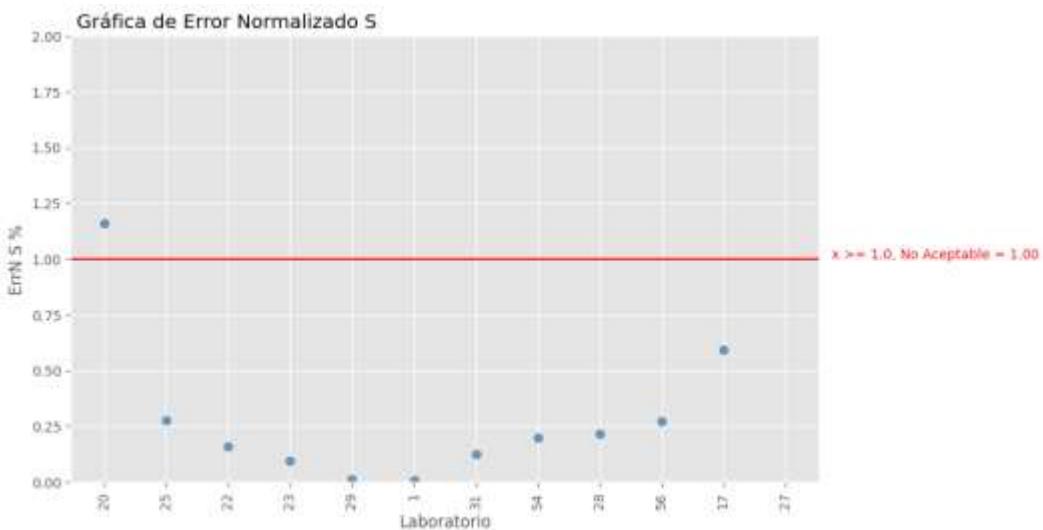
Ag**S**

9. ANALISIS DE LOS RESULTADOS POR TECNICA

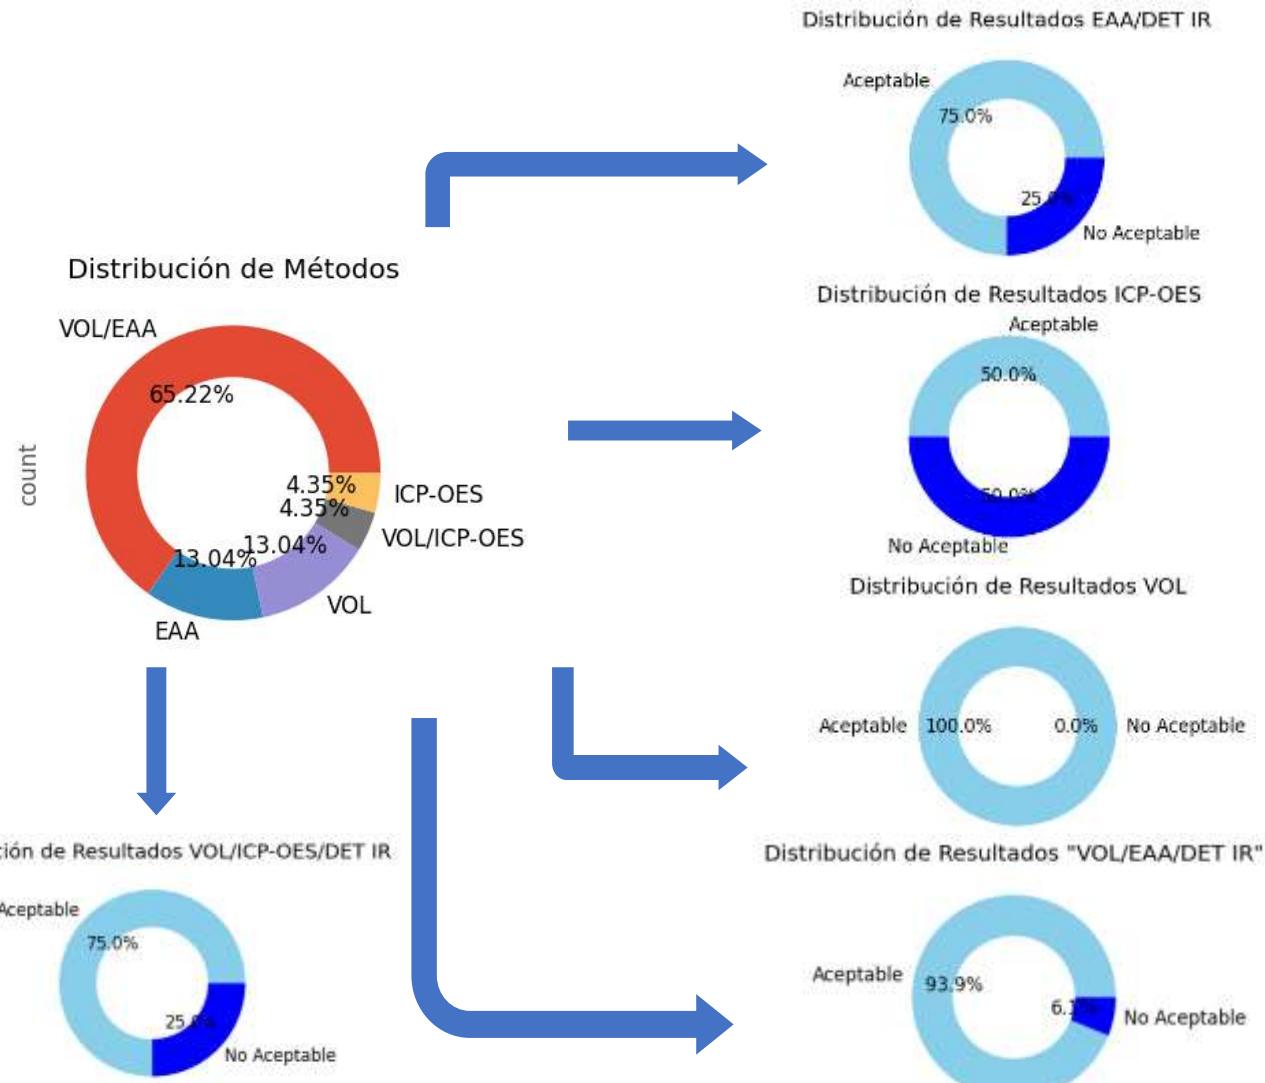


	EAA	ICP-OES	VOL	VOL/EAA	VOL/ICP-OES
Cu	No Aceptable	0	0	0	0
	Aceptable	3	1	3	1
As	No Aceptable	2	1	0	0
	Aceptable	1	0	0	1
Ag	No Aceptable	0	0	0	1
	Aceptable	1	0	1	1
S	No Aceptable	0	0	0	1
	Aceptable	1	0	0	0

Análisis grafico para EAA

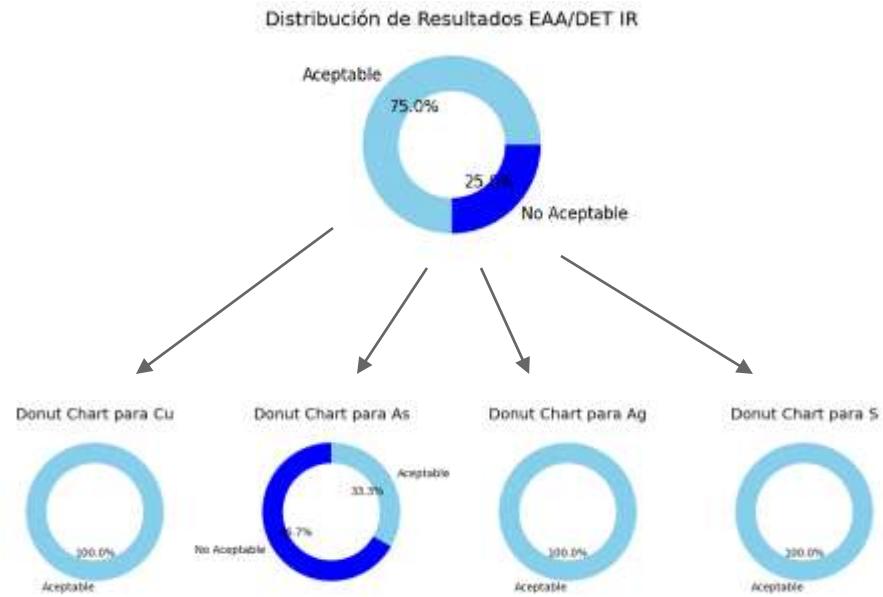


Análisis grafico para ICP-OES

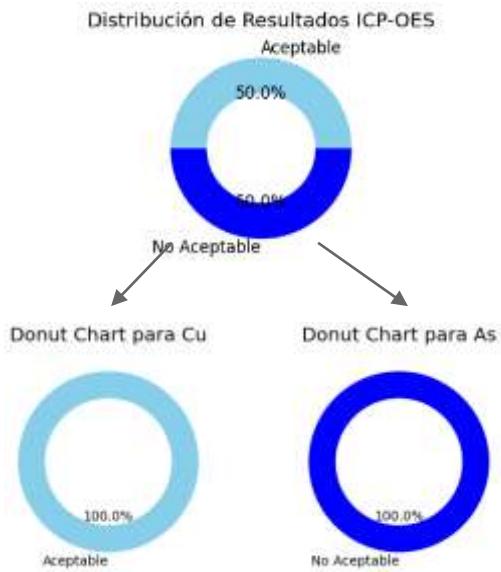


Análisis Grafico por Volumetría

Distribución de Resultados VOL

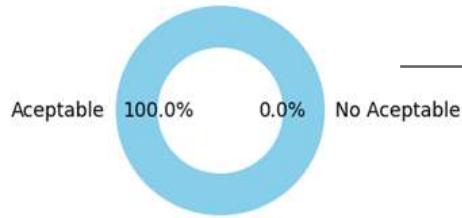


Donut Chart para Cu




Análisis Grafico por Volumetría y Absorción Atómica

Distribución de Resultados "VOL/EAA/DET IR"

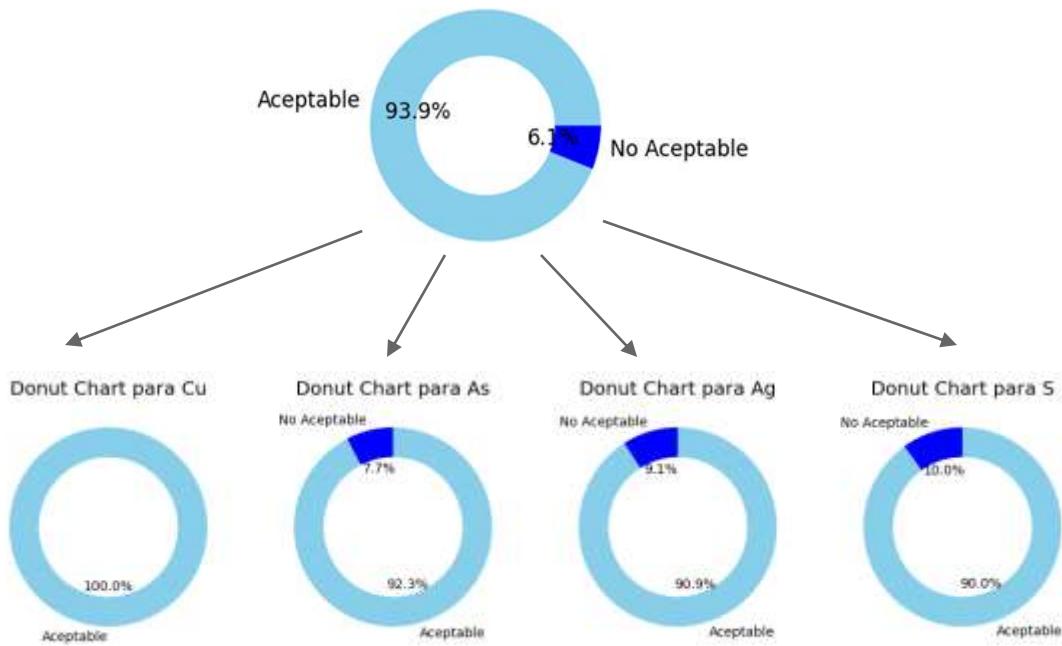

Distribución de Resultados VOL/ICP-OES/DET IR

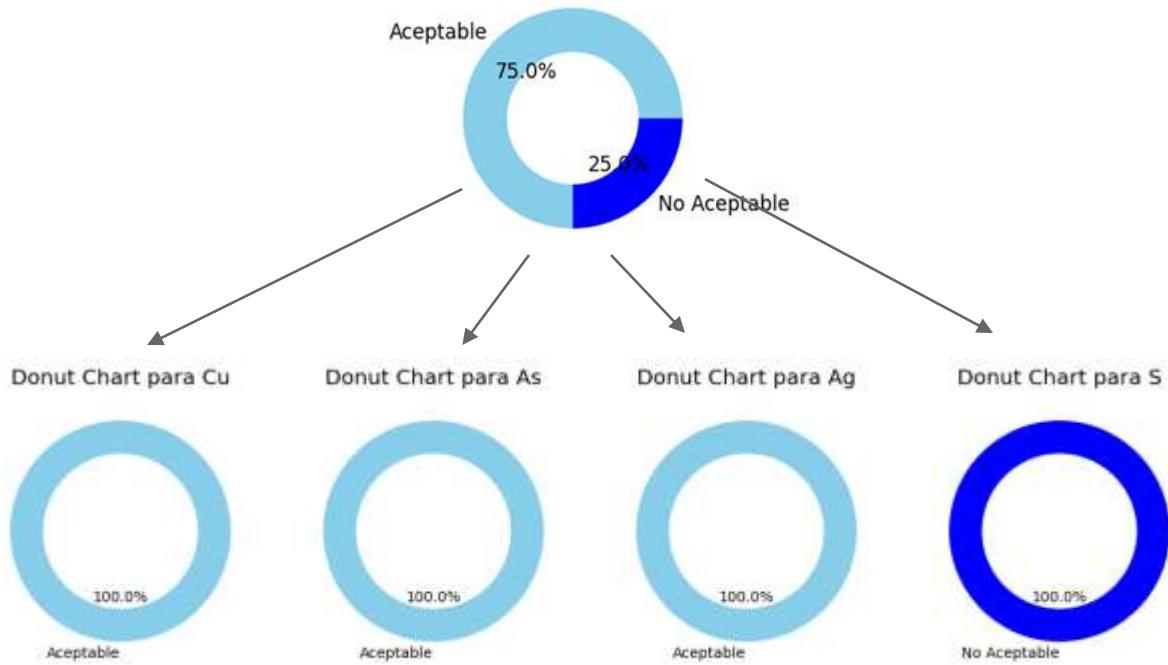

10. RESUMEN

En la siguiente tabla indica el “porcentaje” de analitos informados de los laboratorios participantes.

Muestra problema:

	Cu %	U Exp Cu	As %	U Exp As	Ag mg/Kg	U Exp Ag	S %	U Exp S
% Reportados:	100.0	100.0	78.3	78.3	60.9	60.9	52.2	52.2

11. RECOMENDACIONES

Tras analizar detalladamente los resultados de las Ensayo de Aptitud para distintos analitos: cobre, arsénico, plata y Azufre, se han identificado diversos patrones y preocupaciones.

En primer lugar, las mediciones de cobre nos encontramos que todos los participantes del EA presentan un desempeño aceptable con resultados dentro de los parámetros asignados al elemento.

A su vez en el elemento Arsénico la mayoría de los resultados están dentro de los parámetros asignados, solo cuatro participantes presentan un desempeño insuficiente, correspondientes a N° 29, 55, 138 a y 138 b, los datos que están fuera deben revisar su sistema dado que la desviación es grosera con respecto a la media designada.

Para el elemento Ag solo un participante presenta un desempeño Insuficiente, correspondiente al participante N°17.

Con respecto a la estimación de la incertidumbre declarada por los participantes, algunos laboratorios sobreestiman este cálculo, lo que no concuerda con la variabilidad de sus resultados reportados, por lo que es necesario revisar sus cálculos y procedimientos. Los laboratorios que sobreestimaron el cálculo de la incertidumbre es el laboratorio N°56 para plata y N°1 para azufre.

Con respecto a la subestimación del cálculo de la incertidumbre. Solo en elemento As presenta en general una subestimación de la mayoría de los resultados.

Fomentar la colaboración y cooperación entre laboratorios son fundamental en la mejora continua de los análisis minerales. El intercambio de experiencias, metodologías y prácticas entre laboratorios puede ser invaluable para identificar áreas de mejora y adoptar enfoques más eficientes y precisos en los análisis. Establecer plataformas o

foros que fomenten la comunicación abierta y la discusión sobre desafíos comunes puede promover un ambiente colaborativo. Además, la participación en rondas de pruebas interlaboratorio regulares, el intercambio de estándares de referencia y la verificación cruzada de resultados pueden contribuir significativamente a la estandarización y mejora continua de los métodos de análisis. Esta cooperación facilita no solo la identificación y resolución de problemas, sino también el avance conjunto hacia prácticas analíticas más confiables y precisas en la evaluación de minerales.

La importancia de resultados precisos en análisis minerales, especialmente en un país minero con una industria significativa, como en el caso del cobre, no puede ser subestimada. Estos resultados no solo son críticos para la reputación y competitividad de las empresas mineras, sino que también tienen un impacto directo en la economía nacional. El cobre, como principal producto de exportación, representa una parte fundamental de los ingresos del país, y resultados mal reportados o imprecisos podrían conducir a pérdidas significativas para las empresas mineras y, en última instancia, para la economía en su conjunto.

La precisión en las mediciones de contenido de cobre y otros elementos no solo afecta la eficiencia operativa de las empresas mineras, sino que también influye en la toma de decisiones a nivel nacional, incluyendo inversiones, políticas económicas y estrategias de desarrollo. La confiabilidad de estos resultados es crucial para respaldar la credibilidad del país como proveedor confiable en los mercados internacionales y para mantener la competitividad en la industria minera global.

Por ende, la cooperación entre laboratorios para mejorar la precisión y fiabilidad en los análisis minerales no solo es fundamental para las empresas mineras individuales, sino que también es vital para la economía del país en su conjunto. La colaboración y el esfuerzo colectivo para garantizar mediciones precisas son aspectos cruciales para salvaguardar la reputación, la rentabilidad y el papel de liderazgo en la producción de minerales en el mercado mundial.

12. ANEXOS

Anexo 1: Resultados reportados por laboratorios en concentrado de cobre

Lab.	Metodo	Cu %	U Exp Cu	As %	U Exp As	Ag mg/Kg	U Exp Ag S %	U Exp S
1	VOL/EAA	31.2	0.6072	3.479	0.067	603	0.6518	33.3 11.7176
1	VOL/EAA	31.3	0.6072	3.413	0.067	601	0.6518	33.3 11.7176
1	VOL/EAA	31.4	0.6072	3.518	0.067	602	0.6518	33.7 11.7176
1	VOL/EAA	31.2	0.6072	3.429	0.067	605	0.6518	33.7 11.7176
1	VOL/EAA	31.4	0.6072	3.477	0.067	608	0.6518	33.7 11.7176
1	VOL/EAA	31.3	0.6072	3.421	0.067	607	0.6518	33.5 11.7176
8	VOL/EAA	31.125	0.09	3.462	0.03	590.1	3.5	
8	VOL/EAA	31.126	0.09	3.461	0.03	600	3.5	
8	VOL/EAA	31.183	0.09	3.425	0.03	595.5	3.5	
8	VOL/EAA	31.105	0.09	3.47	0.03	594.6	3.5	
8	VOL/EAA	31.135	0.09	3.41	0.03	591.4	3.5	
8	VOL/EAA	31.165	0.09	3.4	0.03	597.5	3.5	
22	VOL/EAA	31.375	0.1	3.416	0.012		33.1 0.7	
22	VOL/EAA	31.362	0.1	3.427	0.012		33.27 0.7	
22	VOL/EAA	31.356	0.1	3.427	0.012		33.3 0.7	
22	VOL/EAA	31.344	0.1	3.433	0.012		33.22 0.7	
22	VOL/EAA	31.344	0.1	3.418	0.012		33.1 0.7	
22	VOL/EAA	31.337	0.1	3.422	0.012		33.1 0.7	
27	VOL/ICP-OES	31.25	0.03	3.39	0.02	560.1	2.5	35.7 0.13
27	VOL/ICP-OES	31.32	0.03	3.41	0.02	571	2.5	36.3 0.13
27	VOL/ICP-OES	31.24	0.03	3.45	0.02	568.4	2.5	36.5 0.13
27	VOL/ICP-OES	31.3	0.03	3.48	0.02	572.2	2.5	35.9 0.13
27	VOL/ICP-OES	31.26	0.03	3.5	0.02	567.5	2.5	36.3 0.13
27	VOL/ICP-OES	31.12	0.03	3.535	0.02	571.1	2.5	35.7 0.13
138-A	ICP-OES	30.67	0.802547229	0.851	0.138148447			
138-A	ICP-OES	30.56	0.802547229	0.749	0.138148447			
138-A	ICP-OES	30.69	0.802547229	0.881	0.138148447			
138-A	ICP-OES	30.65	0.802547229	0.769	0.138148447			
138-A	ICP-OES	30.72	0.802547229	0.865	0.138148447			
138-A	ICP-OES	30.63	0.802547229	0.882	0.138148447			
138-B	EAA	32.09459459	0.721813827	0.943958665	0.062909726			
138-B	EAA	31.98770085	0.721813827	0.988891093	0.062909726			
138-B	EAA	31.89259333	0.721813827	1.013675384	0.062909726			

138-B EAA		32.08184346	0.721813827	0.988279698	0.062909726			
138-B EAA		31.43476547	0.721813827	1.012022073	0.062909726			
138-B EAA		32.14214414	0.721813827	0.998203234	0.062909726			
138-C VOL		31.17256535	0.208450922					
138-C VOL		31.18613029	0.208450922					
138-C VOL		31.16126051	0.208450922					
138-C VOL		31.24923456	0.208450922					
138-C VOL		31.19530909	0.208450922					
138-C VOL		31.07943009	0.208450922					
17 VOL/EAA	30.92	0.16	3.351	0.02	557	8	34.46	0.94
17 VOL/EAA	31.06	0.16	3.296	0.02	560	8	34.46	0.94
17 VOL/EAA	30.92	0.16	3.412	0.02	554	8	34.01	0.94
17 VOL/EAA	30.99	0.16	3.391	0.02	542	8	34.42	0.94
17 VOL/EAA	30.9	0.16	3.389	0.02	546	8	34.55	0.94
17 VOL/EAA	31.12	0.16	3.369	0.02	547	8	34.09	0.94
56 VOL/EAA	31.37	0.307638333	3.409	0.319548	580.8	55.4	33.9	1.785
56 VOL/EAA	31.38	0.307638333	3.42	0.319548	581.1	55.4	33.9	1.785
56 VOL/EAA	31.39	0.307638333	3.424	0.319548	582.1	55.4	33.9	1.785
56 VOL/EAA	31.4	0.307638333	3.444	0.319548	582.1	55.4	34.1	1.785
56 VOL/EAA	31.41	0.307638333	3.456	0.319548	584.5	55.4	34.1	1.785
56 VOL/EAA	31.4	0.307638333	3.463	0.319548	586.2	55.4	34.1	1.785
25 VOL/EAA	31.154	0.126	3.431	0.074	598.4	12.8	32.82	0.33
25 VOL/EAA	31.147	0.126	3.478	0.074	611.6	12.8	32.92	0.33
25 VOL/EAA	31.252	0.126	3.406	0.074	611.8	12.8	33.07	0.33
25 VOL/EAA	31.272	0.126	3.405	0.074	598.2	12.8	33.15	0.33
25 VOL/EAA	31.276	0.126	3.439	0.074	605.5	12.8	33.27	0.33
25 VOL/EAA	31.157	0.126	3.495	0.074	610.6	12.8	33.11	0.33
10 VOL/EAA	31.05	0.097	3.356	0.010	582.8	2.00		
10 VOL/EAA	31.144	0.097	3.378	0.010	582.8	2.00		
10 VOL/EAA	31.105	0.097	3.342	0.010	581.8	2.00		
10 VOL/EAA	31.076	0.097	3.395	0.010	582.8	2.00		
10 VOL/EAA	31.099	0.097	3.341	0.010	581	2.00		
10 VOL/EAA	31.1	0.097	3.392	0.010	580.1	2.00		
5 VOL/EAA	31.286	0.11	3.4343	0.010				
5 VOL/EAA	31.292	0.11	3.4622	0.010				
5 VOL/EAA	31.288	0.11	3.5063	0.010				
5 VOL/EAA	31.266	0.11	3.47198	0.010				
5 VOL/EAA	31.289	0.11	3.4209	0.010				
5 VOL/EAA	31.2635	0.11	3.4294	0.010				
31 VOL/EAA	31.14580786	0.075	3.237	0.239	606	6.5	33.34	0.424
31 VOL/EAA	31.26715516	0.075	3.346	0.239	608	6.5	33.6	0.424

31	VOL/EAA	31.23545354	0.075	3.415	0.239	602	6.5	33.75	0.424
31	VOL/EAA	31.19221784	0.075	3.5	0.239	610	6.5	33.88	0.424
31	VOL/EAA	31.28580775	0.075	3.391	0.239	607	6.5	33.37	0.424
31	VOL/EAA	31.30980498	0.075	3.175	0.239	611	6.5	33.52	0.424
20	VOL/EAA	31.34452	0.12	3.5	0.075	608.013	12.024	32.3	0.44
20	VOL/EAA	31.39967	0.12	3.5	0.075	608.738	12.024	31.5	0.44
20	VOL/EAA	31.43715	0.12	3.5	0.075	607.156	12.024	31.6	0.44
20	VOL/EAA	31.59935	0.12	3.5	0.075	608.243	12.024	31.8	0.44
20	VOL/EAA	31.48189	0.12	3.5	0.075	610.782	12.024	32.2	0.44
20	VOL/EAA	31.59999	0.12	3.5	0.075	610.041	12.024	31.9	0.44
55	EAA	31.373	0.1	6.412	0.02				
55	EAA	31.311	0.1	6.409	0.02				
55	EAA	31.481	0.1	6.394	0.02				
55	EAA	31.488	0.1	6.428	0.02				
55	EAA	31.472	0.1	6.407	0.02				
55	EAA	31.468	0.1	6.403	0.02				
54	VOL/EAA	31.275	0.028	3.475	0.021	580.7	2.177	33.58	0.037
54	VOL/EAA	31.313	0.028	3.502	0.021	587.1	2.177	33.64	0.037
54	VOL/EAA	31.279	0.028	3.499	0.021	580.7	2.177	33.66	0.037
54	VOL/EAA	31.357	0.028	3.479	0.021	583.7	2.177	33.67	0.037
54	VOL/EAA	31.303	0.028	3.439	0.021	580.3	2.177	33.69	0.037
54	VOL/EAA	31.35	0.028	3.45	0.021	583.9	2.177	33.71	0.037
11	VOL	31.224	0.039						
11	VOL	31.218	0.039						
11	VOL	31.247	0.039						
11	VOL	31.188	0.039						
11	VOL	31.247	0.039						
11	VOL	31.26	0.039						
29	VOL/EAA	31.236	0.177	3.665	0.014	586.2	13.5	33.45	0.67
29	VOL/EAA	31.234	0.177	3.668	0.014	585.2	13.5	33.38	0.67
29	VOL/EAA	31.237	0.177	3.674	0.014	586.1	13.5	33.49	0.67
29	VOL/EAA	31.237	0.177	3.674	0.014	585.5	13.5	33.47	0.67
29	VOL/EAA	31.236	0.177	3.668	0.014	585.7	13.5	33.39	0.67
29	VOL/EAA	31.237	0.177	3.67	0.014	586	13.5	33.41	0.67
47	VOL/EAA	31.29	0.068			606.7	5.9		
47	VOL/EAA	31.312	0.068			606.1	5.9		
47	VOL/EAA	31.25	0.068			612.4	5.9		
47	VOL/EAA	31.243	0.068			605.7	5.9		
47	VOL/EAA	31.258	0.068			610	5.9		
47	VOL/EAA	31.218	0.068			604.8	5.9		
63	VOL/EAA	31.168	0.07						

63	VOL/EAA	31.206	0.07					
63	VOL/EAA	31.23	0.07					
63	VOL/EAA	31.234	0.07					
63	VOL/EAA	31.265	0.07					
63	VOL/EAA	31.268	0.07					
28	EAA	31.28244	0.046	3.42647	0.015	593.50	13.2	33.71 0.45
28	EAA	31.23234	0.046	3.42804	0.015	594.20	13.2	33.69 0.45
28	EAA	31.29246	0.046	3.44998	0.015	593.70	13.2	33.62 0.45
28	EAA	31.23234	0.046	3.44214	0.015	599.50	13.2	33.76 0.45
28	EAA	31.259895	0.046	3.4366575	0.015	595.23	13.2	33.70 0.45
28	EAA	31.259895	0.046	3.4366575	0.015	595.23	13.2	33.70 0.45
23	VOL/EAA	31.278	0.002	3.468	0.031			33.25 0.05
23	VOL/EAA	31.278	0.002	3.478	0.031			33.22 0.05
23	VOL/EAA	31.278	0.002	3.438	0.031			33.32 0.05
23	VOL/EAA	31.275	0.002	3.474	0.031			33.3 0.05
23	VOL/EAA	31.275	0.002	3.411	0.031			33.31 0.05
23	VOL/EAA	31.275	0.002	3.41	0.031			33.34 0.05
33	VOL	31.333	0.1			585.1	5	
33	VOL	31.314	0.1			585.4	5	
33	VOL	31.347	0.1			581.2	5	
33	VOL	31.311	0.1			582.2	5	
33	VOL	31.29	0.1			585.4	5	
33	VOL	31.314	0.1			581.4	5	

Anexo 2: Metodología de análisis químico utilizado por laboratorio para Minerales

Laboratorio 1

Concentrado									
Elemento	Método	Masa Muestra (g)	Volumen Aforo ml	Digestión	Condición Final	Línea nm	Rango Cal. mg/L	Gases	Equipo
Cu	Vol.	0.5		HNO ₃ + HClO ₄	50 ml H ₂ O				
Fe	EAA	1.0	100	HNO ₃ + HClO ₄ + H ₂ SO ₄	5% HNO ₃	248.3	0 - 60	C ₂ H ₂ /N ₂ O	Agilent 240 AA
Mo	EAA	1.0	100	HNO ₃ + HClO ₄ + H ₂ SO ₄	5% HNO ₃	313.3	0 - 60	C ₂ H ₂ /N ₂ O	Agilent 240 AA
As	EAA	1	100	HNO ₃ + HCl + HF	10% HCl + 10% H ₃ BO ₃	193.7	0 - 60	Aire C ₂ H ₂	Agilent 240 AA
			10/200						
Ag	EAA	1	100	HNO ₃ + HCl + HF	20% HCl	328.1	0 - 10	Aire C ₂ H ₂	Agilent 240 AA
S	Combustión y detección IR	0.5	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Leco S-844
Zn	EAA	1.0	100	HNO ₃ + HClO ₄ + H ₂ SO ₄	5% HNO ₃	213.9	0 - 40	C ₂ H ₂ /N ₂ O	Varian 240 AA
			(d = 10/200)						
Pb	EAA	1.0	100	HNO ₃ + HClO ₄ + H ₂ SO ₄	5% HNO ₃	283.3	0 - 40	C ₂ H ₂ /Aire	Varian 240 AA
Bi	EAA	1.0	100	HNO ₃ + HClO ₄ + H ₂ SO ₄	5% HNO ₃	223.1	0 - 10	Aire C ₂ H ₂	Varian 240 AA
Sb	EAA	1	50	HNO ₃ + HClO ₄ + H ₂ SO ₄ + HCl	10% HCl	217.6	0-10	Aire C ₂ H ₂	Varian 240 AA

Laboratorio 8

Mineral											
Elemento	Ensayo Acreditado	Código Certificado INN	Método	Masa Muestra (g)	Volumen aforo (ml)	Condición Final	Digestión	Línea nm	Rango Cal. Ug/ml	Gases	Equipo
Cu	No		Vol	0.5	N/A	N/A	HNO ₃ - HClO ₄ - H ₂ SO ₄	N/A	N/A	Bureta 50 ml	
As	NO		EAA	1	200	25% HCl	HNO ₃ - HClO ₄ - H ₂ SO ₄	193.7	25 - 50 - 100 - 200	Nitroso/Ac etileno	VARIAN 240
Ag	NO		EAA	1	200	25% HCl	HNO ₃ - HClO ₄ - HF	328.1	0.5 - 1 - 2.5 - 5 - 10	Aire/Acetileno	VARIAN 240

Laboratorio 19

MINERAL											
Elemento	Ensayo Acreditado	Código Certificado INN	Método	Masa muestra	Volumen aforo ml	Digestión	Condición final	Línea nm	Rango Cal. Ug/ml	Gases	Equipo
Cu	SI	LE 327	Volumetría	0.5 g		HNO ₃ -HClO ₄ -H ₂ SO ₄					
Al	SI	LE 327	EAA	5.0 g	100	HNO ₃ -HClO ₄ -H ₂ SO ₄	10% HCl + 1% Na ₂ SO ₄	193.7	0.0-1.0-2.0-5.0-10.0-20.0-40.0	Aire-Acetileno	VARIAN-240
S	SI	LE 327	Gravimetría	0.5 g							

Laboratorio 27

Condiciones de Análisis									
Elemento	Método	Masa Muestra (gramos)	Volumen Aforo mL	Digestión	Condición Final	Rango Cal. ug/ml	Gases	Equipo	
Cu	Volumetría biosulfato de sodio	0.5000		solución mezcla HNO ₃ -H ₂ SO ₄					
As	Absorción Atómica	0.5000	250	10 mL HNO ₃ , 5 mL HCl, 1 mL HF, 3 mL HClO ₄	HCl al 10 %	0-80	Aire-Acetileno	ICP PLASMA OPTIMA 8300	
S	LECO	1.0000					Oxígeno	S - 200	
Ag	Dosimetría	5.0000		Fusión en horno de copela	Sólido			Microbalanza Sartorius	

Laboratorio 21-A

MINERAL									
Elemento	Método	Masa Muestra	Volumen Aforo mL	Digestión	Condición Final	Línea nm	Rango Cal. mg/L	Gases	Equipo
Cu	ICP OES	500 mg +/- 0.1 mg	200	15 mL HNO ₃ , 5 mL HClO ₄ , 5 mL HF,	25 % HCl	327,393	5-10-25-50-100	Argón/Nitrogeno	iPC AVIO 550 Perkin Elmer
As	ICP OES	500 mg +/- 0.1 mg	200	15 mL HNO ₃ , 5 mL HClO ₄ , 5 mL HF,	25 % HCl	193,696	2,5-20-40-60-80	Argón/Nitrogeno	iPC AVIO 550 Perkin Elmer
Ag	ICP OES	500 mg +/- 0.1 mg	200	15 mL HNO ₃ , 5 mL HClO ₄ , 5 mL HF,	25 % HCl	328,068	0,5-1,0-2,0	Argón/Nitrogeno	iPC AVIO 550 Perkin Elmer

Laboratorio 21-B

MINERAL									
Elemento	Método	Masa Muestra	Volumen Aforo mL	Digestión	Condición Final	Línea nm	Rango Cal. mg/L	Gases	Equipo
Cu	EAA	500 mg +/- 0.1 mg	250	15 mL HNO ₃ , 5 mL HClO ₄ , 5 mL HF,	10 % HCl	327,4	5-10-25-50-100	Aire-Acetileno	Agilent 240 FS AA
As	EAA	500 mg +/- 0.1 mg	250	15 mL HNO ₃ , 5 mL HClO ₄ , 5 mL HF,	10 % HCl	193,7	5-20-40-60-80	Acetileno-Óxido Nitroso	Agilent 240 FS AA
Ag	EAA	1000 mg +/- 0.1 mg	100	15 mL HNO ₃ , 5 mL HClO ₄ , 5 mL HF,	25 % HCl	328,1	2,5-5-10	Aire-Acetileno	Agilent 240 FS AA

Laboratorio 21-C

MINERAL									
Elemento	Método	Masa Muestra	Volumen Aforo mL	Digestión	Condición Final	Línea nm	Rango Cal. mg/L	Gases	Equipo
Cu	Volumetría	500 a 600 mg +/- 0.1 mg	No Aplica	10 mL HF, 15 mL HNO ₃ , 5 mL HClO ₄ , 5 mL HCl, 1 mL H ₂ SO ₄	Siruposo	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Bureta Digital

Laboratorio 17

Elemento	Ensayo acreditado 17025	Método	Masa muestra (gr)	Volumen aforo (ml)	Digestión	Condición final	Línea nm	Rango Cal. ug/ml	Gases	Equipo
cobre	No	Volumetría	0.5		HNO ₃ , HF, HCl, H ₂ SO ₄	Sequedad				
S	No	Detección Infrarroja	0.04						aire, oxígeno	Leco S744
As	No	EAA	1.00	100	HNO ₃ , HF, HCl	Siruposo	193.7	5-10-30-60 ppm	aire acetileno	PirAAcle500
Plata	No	Ensayo a fuego	10.00							Hornos 810B

Laboratorio 56

Laboratorio C-2303-56											
Mineral											
Elemento	Ensayo acreditado 17025	Código certificado INN	Método	Masa Muestra	Volumen Aforo ml.	Digestión	Condición Final	Línea nm	Rango Calibración ug/L	Gases	Equipo
Cu	Sí	LE 1094	Vol	0.5	—	HNO ₃ -HClO ₄	—	—	—	—	—
As	Sí	LE 1094	AA	0.25	250	HNO ₃ -HClO ₄ -HF	10%, 0.1% Na ₂ SO ₄	193.7	10-100	Nitroso-Acetileno	PinAAcle 900
S	No	—	Leco	0.04	—	—	—	—	—	—	Leco CS744
Ag	Sí	LE 1094	AA	0.5	50	HNO ₃ -HClO ₄ -HF	30%, 1% Na ₂ SO ₄	328.1	1-10	Aire-Acetileno	PinAAcle 500

Laboratorio 25

Elemento	Método	Masa Muestra (g)	Volumen Afaro (mL)	Digestión	Condición Final	Línea (nm)	Rango Cal. (ug/ml)	Gases	Equipo
Cu	Volumétrica	0.8	+	HNO ₃ -HClO ₄	H ₂ O	—	—	—	Burrel Automática Brand clase A
Al	EAA	5	50	HNO ₃ -HClO ₄ -Na ₂ SO ₄	1% H ₂ SO ₄	193.7	10-25-50	Aire-C ₂ H ₂	Agilent 240FS AA
As	EAA	2	50	HNO ₃ -HClO ₄ -HF-HCl	25% HCl	328.1	2.5-5.0-10	Aire-C ₂ H ₂	Agilent 240FS AA
S	Combustión	0.05	+	—	—	—	—	O ₂	LECO CS644

Laboratorio 10

Laboratorio INN-DCH 2304											
Concentrado											
Elemento	Ensayo Acreditado 17025	Código Certificado INN	Método	Masa Muestra (g)	Volumen aforo (mL)	Digestión	Condición final	Línea nm	Rango Cal. ug/ml	Gases	Equipo
Cu	Sí	LE 1094	Volumétrica	0.5	—	HNO ₃ -HClO ₄	—	—	—	—	—
As	Sí	LE 1094	EAA	1	100	HNO ₃ -HClO ₄ -H ₂ SO ₄	1% H ₂ SO ₄	193.7	0 - 10 - 25 - 50	Aire/Acetileno	VARAN 240
Ag	Sí	LE 1094	EAA	1	100	HNO ₃ -HClO ₄ -HF	25% HCl	338.3	0 - 0.5 - 1 - 2.5	Aire/Acetileno	VARAN 240

Laboratorio 05

Concentrado Cobre									
Elemento	Método	Masa Muestra	Volumen aforo	Condición final	Línea nm	Rango Cal. Ug/ml	Gases	Equipo	
Cu	Volumétria	0.5							
As	EAA	1	100	10% HCl	193.7	5-10-25-50	Nitroso-Acetileno	EAA	

Laboratorio 31

Concentrado de Cobre										
Elemento	Método	Masa Muestra	Digestión	Condición final	Volumen Aforo ml	Dilución	Línea nm	Rango Cal. Ug/ml	Gases	Equipo
Cu (%)	Volumétria	0.5 g	HNO ₃ -HClO ₄	Síroposo	+	+	+	+	+	Burrel Automático Brand clase A
As (%)	EAA	1 g	HNO ₃ -HClO ₄ + H ₂ SO ₄	Síroposo	100	+	193.7	0-50	Nitroso-Acetileno	Varian 240AA
S (%)	Gravimetrico	0.5 g	+	+	+	+	—	—	—	Burrel Automático Brand clase A
Ag EAA (g/l)	EAA	1 g	HNO ₃ -HClO ₄ + HCl + HF	Secuado	100	+	328.1	0-20	Aire-Acetileno	Varian 240AA

Laboratorio 20

Elemento	Método	Masa muestra	Volumen aforo ml	Digestión	Condición Final	Línea nm	Rango Cal. ug/ml	Gases	Equipo	
Cu	Si	LE 327	Volumétrica	0.25 g	250	HNO3+HClO4+H2SO4	-	-	-	
Tl	Si	LE 517	m	0.1 g	-	-	-	-	-	LECO 844
As	Si	LE 517	EAA	0.0 g	100	HNO3+HClO4+H2SO4	10% HCl + 1% NaClO4	193.7	0.0-1.0-2.0-5.0-10.0-20.0-40.0	Nitroso-Acetileno VARIAN 240
Ag	Si	LE 327	EAA	1.0 g	100	HNO3+HClO4+HF	25% HCl	328.1	0.0-1.0-2.5-5.0	Nitroso-Acetileno VARIAN 240

Laboratorio 55

Código del Laboratorio:											
HNO3C 20 mL, HCl 1 mL, HClO4C 5 mL											
Elemento	Método	Masa Muestra (g)	Volumen de Aforo (ml)	Ácidos (Tipo y Cantidad)	Factor de Dilución	Medio Ácido Final (%)	Adición de acondicionadores	Línea nm	Gases	Rango Calibración	Equipo
Cobre	EAA Digestión ácida	0.0000 ± 0.001g	200	HNO3C 10 mL, HClO4C 3 mL, H2SO4C 0.5 mL	1-10	5% HCl	-	324.8 nm	Aire/Acetileno	5-15-30 ppm	EAA Varian 55B
Arsenico	EAA Digestión ácida	1.0000g ± 0.001g	100	HNO3C 10 mL, HClO4C 3 mL, H2SO4C 0.5 mL	1	5% HCl	-	193.7 nm	N2O/Acetileno	10-20-50 ppm	EAA Varian 55B

Laboratorio 54

Elemento	Ensayo acreditado 17025	Código Certificado INN	Método	Masa muestra (g)	Aforo (ml)	Digestión	Condición Final	Línea (nm)	Gases	Rango Calibración (ug/ml)	Gases	Equipo
Cu	Si	LE666	Volumétrica	0.4000 mpxox.	—	10 mL HNO3; 5 mL HClO4	lirupeso	—	—	—	—	Bureta Digital
Ag	No	—	Ensayo a Fuego	10.0000 aprox.	—	—	Balan Ag	—	—	—	—	Ultra Micro Balanza Tectorius
As	Si	LE666	Absorción Atómica	0.5000 aprox.	250	10 mL HNO3; 5 mL HClO4; 5mL H2SO4	Síruposil	193.7	N2O/Acetileno	25 - 50 - 100 1% H2SO4	Aire/Acetileno	Varian AA240
S	Si	LE666	Infrarrojo	0.1000 mpxox	—	—	—	—	Aire/Oxígeno	—	—	LECO 844

Laboratorio 11

Concentrado de Cobre											
Elemento	Ensayo Acreditado 17025	Código Certificado INN	Método	Masa Muestra (g)	Volumen Aforo (ml)	Digestión	Condición Final	Línea (nm)	Rango Cal. (ug/ml)	Gases	Equipo
Cu	Si	LE 1538	Volumétrica	0.5	—	HNO3-HClO4	Acuoso	—	—	—	

Laboratorio 29

Elemento	Ensayo Acreditado 17025	Código Certificado INN	Método	Masa (g)	Vol. Final (ml)	Digestión	Molécula Final	Línea (nm)	Rango Calibración ug/ml	Gases usados	Equipo
Ca	Si		Volumétrica indirecta (Volumétrica)	0.5	—	—	—	—	—	—	—
As	No		EAA	0.5	250	HNO3- H2SO4	1% H2SO4	193.7	25-50-100	Nitroso-C2H2	Agilent 280 FS
Ag	No		EAA	1	100	HNO3- HClO4- HF-HCl	25% HCl	328.1	2.5-5-10	Aire-C2H2	Agilent 280 FS
S	No					Leco (Combustión directa / Detección infrarroja) 0.05 g					Leco CS-644

Laboratorio 47

Elemento	Método	Masa Muestra g	Volumen aforo ml	Digestión	Condición Final	Línea nm	Rango Cal. ug/ml	Gases	Equipo
Cu %	Volumétrica	0,5 - 1,0	—	HNO3- HClO4	—	—	—	—	
Ag g/t	EAA	0,5 - 1,0	50	HNO3- HCl- HClO4- HF	25% HCl	328.1	0,5 - 2,5 mg/L	C2H2 - Aire	Agilent 500

Laboratorio 63

Elemento	Ensayo acreditado 17025	Código Certificado INN	Método	Masa Muestra	Volumen aforo ml	Digestión	Condición Final	Línea nm	Rango Cal. ug/ml	Gases	Equipo
Cobre	Sí	LE222	Vol	0,5 g	N/A	10 mL HNO ₃ + 4 mL HClO ₄	líquido	N/A	N/A	N/A	Bureta analítica
S	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Arsenico	No	N/A	EAA	1,0 g	100	15 mL HNO ₃ + 4 mL HClO ₄ +1mL H ₂ SO ₄	sequedad	193.7	5 - 10 - 50 mg/l	C2H ₂ -N ₂ O	Thermo S-Series
Plata	No	N/A	EAA	1,0 g	100	15 mL HNO ₃ + 4 mL HClO ₄ +1mL H ₂ SO ₄	sequedad	328.1	0.5 - 1 - 2 mg/l	C2H ₂ Aire	Thermo S-Series

Laboratorio 28

Elemento	ensayo acreditado	Método	Masa (gr)	Vol. Final (ml)	Ácidos (ml) para digestión en placas	Matriz final	Línea espectral para la medición E.A.A	Rango Calibración	Gases usados	Equipo
Ag	iii	E.A.A.	0.5	100	HNO ₃ -HCl-HClO ₄ -HF	25% HCl	328.1	1 st Curva 0.5-1.0-2.5	Aire-C ₂ H ₂	Thermo iCE 3000
As	Sí	E.A.A.	1	100	HNO ₃ -H ₂ SO ₄	10% HCl	193.7	1 st Curva 5.0-10-25 / 2 nd 10-25-50	Nitroso-C ₂ H ₂	Agilent 280 PS
S	no				Leco [Combustión directa / Desección infrarroja] 0.05 g					Leco CS-744
Cu	iii	Volumétrica indirecta (redoximétrica)	0.5							

Laboratorio 23

Elemento	Método	Masa Muestra (g)	Ácidos (Tipo y Cantidad)	Factor de Dilución
Cu	VOLUMETRÍA CORTA	0,5000 g	15 mL HNO ₃ / 5 mL HClO ₄	-
S	FUSIÓN PERÓXIDO	0,2500 g	20 mL HCl	2000
As	ATÁQUE ÁCIDO	1,000 g	10 mL Agua Regia 1:1	100
Fe	FUSIÓN PERÓXIDO	0,2500 g	20 mL HCl	2000

Laboratorio 33

Elemento	Ensayo Acreditado 17025	Código Certificado INN	Método	Masa Muestra	Volumen aforo ml	Digestión	Condición Final	Línea nm	Rango Cal. ug/ml	Gases	Equipo
Cobre	Sí	LE-289	Iodometria	0.5	n/a	HNO ₃ - KClO ₄	N/A	N/A	N/A	N/A	Bureta Digital
Plata	Sí	LE-289	fire assay	5.0	n/a	litrario, mezcla fundente	N/A	N/A	N/A	N/A	Microbalanza SE2

Anexo 3: Evaluación de desempeño de Error Normalizado

Cobre

	Lab.	Cu %		U Exp Cu	X	Y	ErrCu	Condición
		mean	std					
0	138-A	30.653	0.055	0.803	0.547	1.005	0.544	Aceptable
1	17	30.985	0.089	0.160	0.215	0.626	0.344	Aceptable
2	10	31.096	0.031	0.097	0.104	0.613	0.170	Aceptable
3	8	31.140	0.029	0.090	0.060	0.612	0.098	Aceptable
4	138-C	31.174	0.055	0.208	0.026	0.640	0.041	Aceptable
5	25	31.210	0.063	0.126	0.010	0.618	0.016	Aceptable
6	63	31.228	0.038	0.070	0.029	0.609	0.047	Aceptable
7	11	31.231	0.026	0.039	0.031	0.606	0.051	Aceptable
8	29	31.236	0.001	0.177	0.036	0.630	0.057	Aceptable
9	31	31.239	0.061	0.075	0.039	0.610	0.065	Aceptable
10	27	31.248	0.070	0.030	0.048	0.606	0.080	Aceptable
11	28	31.260	0.025	0.046	0.060	0.607	0.099	Aceptable
12	47	31.262	0.034	0.068	0.062	0.609	0.102	Aceptable
13	23	31.276	0.002	0.002	0.076	0.605	0.126	Aceptable
14	5	31.281	0.013	0.110	0.081	0.615	0.131	Aceptable
15	1	31.300	0.089	0.607	0.100	0.857	0.117	Aceptable
16	54	31.313	0.035	0.028	0.113	0.606	0.186	Aceptable
17	33	31.318	0.020	0.100	0.118	0.613	0.193	Aceptable
18	22	31.353	0.014	0.100	0.153	0.613	0.250	Aceptable
19	56	31.392	0.015	0.308	0.192	0.679	0.282	Aceptable
20	55	31.432	0.073	0.100	0.232	0.613	0.379	Aceptable
21	20	31.477	0.105	0.120	0.277	0.617	0.449	Aceptable
22	138-B	31.939	0.263	0.722	0.739	0.942	0.785	Aceptable

Arsénico

Lab.	As %		U Exp As	X	Y	ErrAs	Condicion
	mean	std					
0	138-A	0.833	0.059	0.138	2.640	0.219	12.053 No Aceptable
1	138-B	0.991	0.025	0.063	2.482	0.181	13.693 No Aceptable
2	31	3.344	0.120	0.239	0.129	0.293	0.440 Aceptable
3	10	3.367	0.024	0.010	0.106	0.170	0.620 Aceptable
4	17	3.368	0.041	0.020	0.105	0.171	0.613 Aceptable
5	22	3.424	0.006	0.012	0.049	0.170	0.288 Aceptable
6	56	3.436	0.022	0.320	0.037	0.362	0.102 Aceptable
7	28	3.437	0.009	0.015	0.036	0.171	0.213 Aceptable
8	8	3.438	0.030	0.030	0.035	0.173	0.203 Aceptable
9	25	3.442	0.037	0.074	0.031	0.185	0.165 Aceptable
10	23	3.447	0.031	0.031	0.026	0.173	0.153 Aceptable
11	5	3.454	0.032	0.010	0.019	0.170	0.111 Aceptable
12	1	3.456	0.042	0.067	0.017	0.183	0.092 Aceptable
13	27	3.461	0.055	0.020	0.012	0.171	0.071 Aceptable
14	54	3.474	0.025	0.021	0.001	0.171	0.006 Aceptable
15	20	3.500	0.000	0.075	0.027	0.186	0.145 Aceptable
16	29	3.670	0.004	0.014	0.197	0.171	1.154 No Aceptable
17	55	6.409	0.011	0.020	2.936	0.171	17.151 No Aceptable

Plata

index	Lab.	Ag mg/Kg		U Exp Ag	X	Y	ErrAg	Condicion
		mean	std	mean				
0	6	17	551.000	7.043	8.000	39.405	31.027	1.270 No Aceptable
1	11	27	568.383	4.431	2.500	22.022	30.082	0.732 Aceptable
2	1	10	581.883	1.139	2.000	8.522	30.045	0.284 Aceptable
3	18	54	582.733	2.667	2.177	7.672	30.057	0.255 Aceptable
4	20	56	582.800	2.113	55.400	7.605	62.991	0.121 Aceptable
5	15	33	583.450	2.057	5.000	6.955	30.392	0.229 Aceptable
6	13	29	585.783	0.387	13.500	4.622	32.878	0.141 Aceptable
7	22	8	594.850	3.701	3.500	4.445	30.182	0.147 Aceptable
8	12	28	595.227	2.219	13.200	4.822	32.755	0.147 Aceptable
9	0	1	604.333	2.805	0.652	13.928	29.985	0.465 Aceptable
10	10	25	606.017	6.403	12.800	15.612	32.596	0.479 Aceptable
11	14	31	607.333	3.204	6.500	16.928	30.675	0.552 Aceptable
12	16	47	607.617	2.943	5.900	17.212	30.553	0.563 Aceptable
13	7	20	608.829	1.349	12.024	18.424	32.299	0.570 Aceptable

Azufre

index	Lab.	S %		U Exp S	X	Y	ErrS	Condicion
		mean	std	mean				
0	7	20	31.883	0.319	0.440	1.527	1.316	1.160 No Aceptable
1	10	25	33.057	0.162	0.330	0.353	1.283	0.275 Aceptable
2	8	22	33.182	0.093	0.700	0.228	1.424	0.160 Aceptable
3	9	23	33.290	0.046	0.050	0.120	1.241	0.097 Aceptable
4	13	29	33.432	0.045	0.670	0.022	1.409	0.015 Aceptable
5	0	1	33.533	0.197	11.718	0.123	11.783	0.010 Aceptable
6	14	31	33.577	0.212	0.424	0.167	1.310	0.127 Aceptable
7	18	54	33.658	0.045	0.037	0.248	1.241	0.200 Aceptable
8	12	28	33.697	0.045	0.450	0.287	1.319	0.217 Aceptable
9	20	56	34.000	0.110	1.785	0.590	2.173	0.271 Aceptable
10	6	17	34.332	0.224	0.940	0.922	1.556	0.592 Aceptable
11	11	27	36.067	0.344	0.130	2.657	1.247	2.131 No Aceptable